

Литера О₁

26.51.53.110

Утвержден

ИБЯЛ.413411.054 РЭ2-ЛУ



ДАТЧИКИ-ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ПАРОВ КРТ

ДАРТ

Руководство по эксплуатации часть 3

ИБЯЛ.413411.054 РЭ2

Содержание

	Лист
1 Описание и работа	5
1.1 Назначение газоанализаторов	5
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Состав газоанализаторов	13
1.4 Устройство и работа	14
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	18
1.6 Маркировка и пломбирование	20
1.7 Упаковка	22
2 Использование по назначению	23
2.1 Общие указания по эксплуатации	23
2.2 Подготовка газоанализаторов к использованию	25
2.3 Использование газоанализаторов	30
2.3.1 Порядок работы	30
2.3.2 Методика измерений	32
2.3.3 Возможные неисправности и способы их устранения	33
3 Техническое обслуживание	34
3.1 Регламент проведения технического обслуживания и его объем	34
3.2 Меры безопасности	35
3.3 Порядок технического обслуживания газоанализаторов	36
3.4 Проверка работоспособности газоанализаторов	44
3.5 Техническое освидетельствование	45
3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)	46
4 Текущий ремонт	48
4.1 Организация ремонта	48
4.2 Меры безопасности	48
4.3 Требования на дефектацию	49
4.4 Текущий ремонт составных частей газоанализаторов	51
5 Хранение	54
6 Транспортирование	55
Приложение А (обязательное) Датчики-газоанализаторы паров КРТ ДАРТ.	
Монтажный чертеж	56

Приложение Б (справочное) Описание регистров и команд, используемых газоанализаторами по цифровому каналу связи с протоколом MODBUS RTU	57
Приложение В (справочное) Схема пломбировки газоанализаторов от несанкционированного доступа	61
Приложение Г (обязательное) Техническая характеристика ПГС, используемая при корректировке чувствительности газоанализаторов	62
Приложение Д (справочное) Инструкция по применению раствора гипохлорита натрия	63
Перечень принятых сокращений	65



Перед началом работ, пожалуйста, прочтите настоящее руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное использование датчика-газоанализатора паров КРТ ДАРТ модификации ДАРТ-А (в дальнейшем – газоанализаторы), позволит сэкономить средства на сервисное обслуживание и обеспечит надежные результаты измерений.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в руководстве по эксплуатации возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических и метрологических характеристик газоанализаторов и включает в себя сведения, необходимые для правильной подготовки к монтажу, пуску и регулированию. Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания газоанализаторов.

Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под регистрационным номером 65301-16 (см. сайт ФГИС «АРШИН» <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4>).

Газоанализаторы соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011.

Копии документов, подтверждающих соответствие газоанализаторов установленным техническим требованиям, находятся в комплекте эксплуатационной документации, а также размещены на сайте изготовителя.

Изготовитель: ФГУП «СПО «Аналитприбор».

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3.

Тел.: +7 (4812) 31-11-68 (отдел маркетинга), 31-32-39, 30-61-37 (ОТК).

Факс: +7 (4812) 31-75-18 (центральный), 31-33-25 (ОТК).

Бесплатный звонок по России: 8-800-100-19-50.

E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru, market@analitpribor-smolensk.ru.

Сайты: www.analitpribor-smolensk.ru, аналитприбор.рф.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение газоанализатора

1.1.1 Газоанализаторы предназначены для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации паров гидразин-гидрата (ГОСТ 19503—88) в воздухе.

1.1.2 Область применения газоанализаторов – обеспечение автоматического непрерывного контроля содержания вредных веществ - паров гидразин-гидрата в воздухе рабочей зоны помещений, в том числе на атомных станциях.

Сфера применения газоанализаторов в соответствии с Федеральным законом 102-ФЗ – «выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда».

Газоанализаторы предназначены для использования в невзрывоопасных зонах.

1.1.3 Тип газоанализаторов – стационарный.

Режим работы – непрерывный.

Принцип измерений – электрохимический.

Способ отбора пробы – принудительный, обеспечивается встроенным побудителем расхода.

1.1.4 Обозначения и условное наименование газоанализаторов, химическая формула определяемого компонента, зона размещения соответствуют данным, приведенным в таблице 1.1.

Т а б л и ц а 1.1

Обозначение газоанализаторов	Условное наименование газоанализаторов	Химическая формула определяемого компонента	Зона размещения
ИБЯЛ.413411.054-02	ДАРТ-А	$N_2H_4 \cdot H_2O$	Невзрывоопасная

1.1.5 Вывод измерительной информации осуществляется:

- в форме выходного сигнала постоянного тока;
- в кодированной форме по цифровому каналу связи.

1.1.6 Степень защиты газоанализаторов по ГОСТ 14254—2015 – IP65.

1.1.7 Питание газоанализаторов осуществляется от источника напряжения постоянного тока с напряжением от 18 до 32 В.

1.1.8 По способу защиты персонала от поражения электрическим током газоанализаторы относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0—75.

1.1.9 Газоанализаторы относятся к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931—2008.

1.1.10 Газоанализаторы относятся к классу безопасности 4 (классификационное обозначение 4Н) по НП-001-15 – элементы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность.

1.1.11 Газоанализаторы, при использовании на атомных станциях, относятся к квалификационной категории R4 (общепромышленная) по СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 – приборы, способные выполнять проектные функции при нормальных условиях эксплуатации.

1.1.12 Газоанализаторы, при использовании на атомных станциях, относятся к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

1.1.13 По характеру применения газоанализаторы, при использовании на атомных станциях, по ГОСТ 25804.1-83 относятся к категории Б – аппаратура непрерывного применения.

1.1.14 По числу уровней качества функционирования по ГОСТ 25804.1-83 газоанализаторы, при использовании на атомных станциях, относятся к виду II – аппаратура, имеющая более двух уровней качества функционирования: работоспособное состояние, частично работоспособное состояние и отказ.

1.1.15 Группа условий эксплуатации газоанализаторов – 1.3 по СТО 1.1.1.07.001.0675-2017.

Допускается эксплуатация газоанализаторов в условиях, соответствующих группам условий эксплуатации 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 по СТО 1.1.1.07.001.0675-2017.

1.1.16 По устойчивости к механическим воздействиям газоанализаторы относятся к группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.1.17 Газоанализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

1.1.18 По устойчивости к воздействию климатических факторов газоанализаторы соответствуют климатическому исполнению В категории 4.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от плюс 1 до плюс 45 °С.

1.1.19 Газоанализаторы обеспечивают выполнение следующих функций:

- измерение массовой концентрации паров гидразин-гидрата в воздухе;
- выдачу выходного сигнала постоянного тока (4–20) мА, пропорционального измеренному значению массовой концентрации;

- выдачу прерывистой световой сигнализации красного цвета СИГНАЛИЗАЦИЯ, свидетельствующей о достижении измеренным значением массовой концентрации порога срабатывания сигнализации ПОРОГ1;

- выдачу прерывистой световой сигнализации повышенной частоты красного цвета СИГНАЛИЗАЦИЯ, свидетельствующей о достижении измеренным значением массовой концентрации порога срабатывания сигнализации ПОРОГ2;

- выдачу световой индикации зеленого цвета **ПИТАНИЕ** при подключении газоанализаторов к источнику напряжения питания постоянного тока;
- выдачу непрерывной световой индикации красного цвета **СИГНАЛИЗАЦИЯ** и фиксированного значения тока $(1,0 \pm 0,2)$ мА либо $(2,0 \pm 0,2)$ мА в линию выходного сигнала постоянного тока при неисправности газоанализаторов;
- связь с ВУ по цифровому каналу связи.

1.1.20 Условия эксплуатации газоанализаторов:

- диапазон температуры окружающей среды от 1 до 45°C ;
- диапазон атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- диапазон относительной влажности окружающей среды без конденсации влаги, при температуре 25°C от 30 до 80 %;
- массовая концентрация пыли в воздухе не более 10^{-2} г/м³;
- рабочее положение - вертикальное, угол наклона в любом направлении не более 5° ;
- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения, равной 0,35 мм;
- содержание коррозионно-активных агентов в атмосфере типа II по ГОСТ 15150—69 на открытом воздухе составляет:

- а) хлоридов – до $0,3$ мг/(м²·сут) ($0,02$ мг/м³);
- б) сульфатов – до $0,03$ мг/м³;
- в) сернистого газа – до $0,31$ мг/м³.

Для газоанализаторов, размещаемых в закрытых помещениях, верхний предел содержания коррозионно-активных агентов принимается равным 60 % от содержания на открытом воздухе.

Характеристики анализируемой среды (пробы) на входе газоанализаторов:

- расход $(0,75 \pm 0,25)$ дм³/мин;
- температура пробы равна температуре окружающей среды;
- диапазон давления (абсолютное) от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- диапазон относительной влажности анализируемой смеси от 30 до 80 %;
- массовая концентрация пыли и других взвешенных частиц не более $0,001$ г/м³.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Электрическое питание газоанализаторов осуществляется от источника постоянного тока с напряжением от 18 до 32 В.

Конструктивными решениями в газоанализаторах быть предусмотрена защита от изменения полярности питающей сети.

1.2.2 Мощность, потребляемая газоанализаторами - не более 25 Вт.

1.2.3 Габаритные размеры газоанализаторов, мм, не более:

длина – 270;

ширина – 250;

высота – 480.

1.2.4 Масса газоанализаторов - не более 20 кг.

1.2.5 Газоанализаторы имеют выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА по ГОСТ 26.011—80 со следующими характеристиками:

- допустимое сопротивление нагрузки — не более 500 Ом;

- пульсации напряжения - не более 6 мВ при сопротивлении нагрузки 50 Ом.

1.2.6 Газоанализаторы имеют цифровой канал связи с ВУ со следующими характеристиками:

- интерфейс RS485, скорость обмена 9600 бод;

- протокол обмена – MODBUS RTU;

- номинальная цена единицы наименьшего разряда кода – 0,001 мг/м³;

- вид выходного кода – двоично-десятичный (BCD), число разрядов – 4.

1.2.7 Диапазон измерений массовой концентрации паров гидразин-гидрата газоанализаторов – от 0,0 до 1,0 мг/м³.

Диапазон показаний газоанализаторов совпадает с диапазоном измерений.

1.2.8 Пределы допускаемой основной абсолютной Δ_d (относительной δ_d) погрешности газоанализаторов соответствуют данным, приведенным в таблице 1.2.

Т а б л и ц а 1.2

Пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов	Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность, мг/м ³
$\Delta_d = \pm 0,025$ мг/м ³	от 0,0 до 0,1 включ.
$\delta_d = \pm 25$ %	свыше 0,1 до 1,0

1.2.9 Номинальная статическая функция преобразования газоанализаторов по выходному сигналу постоянного тока I , мА, имеет вид

$$I = I_n + K_p \cdot C_{vx}, \quad (1.1)$$

где I_n – нижняя граница диапазона выходного сигнала постоянного тока, равная 4 мА;

C_{vx} – действительное значение содержания определяемого компонента на входе газоанализаторов, массовая концентрация, $\text{мг}/\text{м}^3$;

K_p – номинальный коэффициент преобразования, равный $16 \text{ мА}/\text{мг}/\text{м}^3$.

1.2.10 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от 1 до 45°C , от значения температуры, при которой определялась основная погрешность - 1,0 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.11 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов при изменении атмосферного давления в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа, от значения давления, при котором определялась основная погрешность - 1,0 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.12 Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализаторов при изменении относительной влажности анализируемой газовой смеси в диапазоне от 30 до 80 % от номинального значения относительной влажности 60 % при температуре 25°C - 1,5 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

1.2.13 Время прогрева газоанализаторов - не более 30 мин.

1.2.14 Предел допускаемого интервала времени непрерывной работы газоанализаторов без корректировки показаний по ПГС - 12 месяцев.

1.2.15 Время срабатывания сигнализации превышения пороговых значений СИГНАЛИЗАЦИЯ – не более 5 мин.

При выпуске из производства установлены следующие значения порогов:

- ПОРОГ1 – $0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$;
- ПОРОГ2 – $0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$.

1.2.16 Предел допускаемого времени установления выходного сигнала $T_{0,9\text{ном}}$ - не более 10 мин.

1.2.17 Газоанализаторы устойчивы к воздействию неопределляемых компонентов с содержанием:

- оксид углерода – до $20 \text{ мг}/\text{м}^3$;
- диоксид углерода – до 1000 млн^{-1} , объемной доли;
- формальдегид – до $0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$;
- фенол – до $1,0 \text{ мг}/\text{м}^3$;

- этиловый спирт – до 2,0 г/м³;
- уксусная кислота – до 2,0 мг/м³;
- алкилзамещенные гидразины, гидразин – до 0,5·ПДК.

1.2.18 Газоанализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, для использования в промышленной электромагнитной обстановке.

1.2.19 Газовый канал газоанализаторов герметичен при испытании его манометрическим вакуумным методом. При разрежении в газовом канале 29,4 кПа (0,3 кгс/см²) повышение давления – не более 750 Па (0,0076 кгс/см²) за контрольное время 30 мин.

1.2.20 Встроенное программное обеспечение (далее – ПО) газоанализаторов соответствует ГОСТ Р 8.654-2015. Уровень защиты ПО и измерительной информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений осуществляется посредством механического опечатывания и соответствует среднему уровню защиты в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные соответствуют значениям, указанным в таблице 1.3.

Т а б л и ц а 1.3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Gidrazin.hex
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1
Цифровой идентификатор ПО	6815
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-16

1.2.21 Расход анализируемой газовой смеси, создаваемый встроенным побудителем расхода - от 0,5 до 1,0 дм³/мин.

1.2.22 Газоанализаторы устойчивы к:

- воздействию синусоидальной вибрации частотой от 10 до 55 Гц, амплитудой 0,35 мм;
- изменению пространственного положения на угол 5° в любом направлении от рабочего;
- изменению напряжения питания от 18 до 32 В.

1.2.23 Газоанализаторы обеспечивают по цифровому каналу связи с ВУ:

- выдачу на ВУ информации об измеренных значениях;
- выдачу на ВУ информации об установленных значениях порогов сигнализации ПОРОГ1, ПОРОГ2;

- выдачу на ВУ номера версии и цифрового идентификатора встроенного ПО;
- прием от ВУ команд на изменение пороговых значений ПОРОГ1, ПОРОГ2;
- прием от ВУ команд на корректировку чувствительности газоанализаторов;
- выдачу на ВУ информации о неисправности газоанализаторов.

1.2.24 Газоанализаторы обеспечивают выдачу фиксированного значения тока $(1,0 \pm 0,2)$ мА либо $(2,0 \pm 0,2)$ мА в линию выходного сигнала постоянного тока при неисправности газоанализаторов.

1.2.25 Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие:

- температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °C;
- ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м/с^2 , длительностью ударного импульса 16 мс, числом ударов (1000 ± 10) ;
- относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °C.

1.2.26 Электрическая изоляция цепей газоанализаторов относительно корпуса и между собой при температуре (20 ± 5) °C и относительной влажности до 80 % выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы 500 В (действующее значение) частотой (50 ± 2) Гц.

1.2.27 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом газоанализаторов – не менее 20 МОм при температуре (20 ± 5) °C и относительной влажности до 80 %.

1.2.28 Средняя наработка до отказа газоанализаторов в условиях эксплуатации, указанных в настоящем РЭ, не менее 35000 ч.

1.2.29 Назначенный срок службы газоанализаторов в условиях эксплуатации, указанных в настоящем РЭ, – 30 лет.

Указанный срок службы обеспечивается регламентированным капитальным ремонтом с полным восстановлением ресурса газоанализаторов.

Периодичность капитального ремонта – 10 лет.

Исчисление назначенного срока службы газоанализаторов должно начинаться с даты ввода газоанализаторов в эксплуатацию, но не далее 6 месяцев от даты приемки газоанализаторов, указанной в свидетельстве о приемке.

По истечении назначенного срока службы газоанализаторы должны быть сняты с эксплуатации.

1.2.30 Средний срок службы ЭХЯ – 2 года.

1.2.31 Назначенный срок хранения газоанализаторов в упаковке изготовителя – 3 года.

1.2.32 Среднее время восстановления работоспособного состояния газоанализаторов – не более 6 ч.

1.2.33 Газоанализаторы при поставке на атомную станцию работоспособны после пребывания до 15 суток ежегодно в неработающем состоянии при температуре окружающего воздуха от 5 до 45 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 °C и более низких температурах без конденсации влаги в атмосфере типа II, по ГОСТ 15150-69, с содержанием: хлоридов – до $0,3 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$ ($0,02 \text{ мг}/\text{м}^3$); сульфатов – до $0,03 \text{ мг}/\text{м}^3$; сернистого газа – до $0,31 \text{ мг}/\text{м}^3$.

1.2.34 Конструкция газоанализаторов, при поставке на атомную станцию, обеспечивает при дезактивации помещений возможность дезактивации наружных поверхностей газоанализатора следующими растворами согласно СТО 1.1.1.07.001.0675-2017:

- раствор 1: едкий натр (NaOH) – (50 - 60) г/л; перманганат калия (KMnO₄) – (5 - 10) г/л;
- раствор 2: щавелевая кислота (H₂C₂O₄) – (20 - 40) г/л.

1.2.35 Газоанализаторы, при поставке на атомную станцию, устойчивы к воздействию внешнего радиационного фона окружающей среды.

Мощность поглощенной дозы в рабочих условиях эксплуатации – не более $1,4 \cdot 10^{-6}$ Гр/с.

1.2.36 Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности – 6,0 %.

1.3 Состав газоанализаторов

1.3.1 Состав газоанализаторов соответствует указанному в таблице 1.4.

Т а б л и ц а 1.4

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ИБЯЛ.413411.054-02	Датчик-газоанализатор паров КРТ ДАРТ	1 шт.	
ИБЯЛ.413411.054 ВЭ	Ведомость эксплуатационных документов	1 экз.	
	Комплект эксплуатационных документов	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.413411.054 ВЭ
	Комплект ЗИП	1 компл.	Согласно ведомости ЗИП
П р и м е ч а н и е - Баллоны с ГСО-ПГС изготовитель поставляет по отдельному договору.			

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип измерений

1.4.1.1 Принцип измерений газоанализаторов – электрохимический, основанный на электрохимическом окислении паров гидразин-гидрата на поверхности рабочего электрода электрохимической ячейки (далее – ЭХЯ). Электрический ток, который возникает при этом, пропорционален содержанию паров гидразин-гидрата в анализируемой среде.

1.4.2 Устройство газоанализаторов

1.4.2.1 Газоанализаторы являются одноблочными стационарными приборами.

1.4.2.2 Внешний вид газоанализаторов представлен на рисунке 1.1.

Доступ к внутреннему объему корпуса газоанализатора (поз. 1) закрывается крышкой (поз. 2). Внутри корпуса размещается блок аналитический (поз. 12). В нижней части корпуса расположены:



- ввод кабельный (поз. 15) для подключения кабеля питания и связи;
- клапан дренажный (поз. 17);
- штуцер «ВХОД ПРОБЫ» (поз. 14);
- штуцер «СБРОС ПРОБЫ» (поз. 16).

1.4.2.3 На крышке (поз. 2) расположены:


- лампа индикационная зеленая «ПИТАНИЕ» (поз. 4);
- лампа индикационная красная «СИГНАЛИЗАЦИЯ» (поз. 5).

1.4.2.4 В состав блока аналитического входят:

- колодки клеммные для подключения кабеля питания и связи (назначение контактов приведено в приложении А);
- фильтр поглотитель (поз. 7);
- ячейка электрохимическая (поз. 13);
- побудитель расхода пробы (поз. 11).

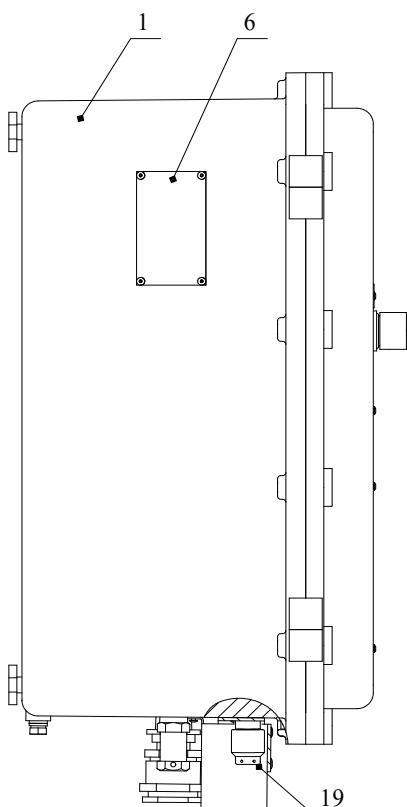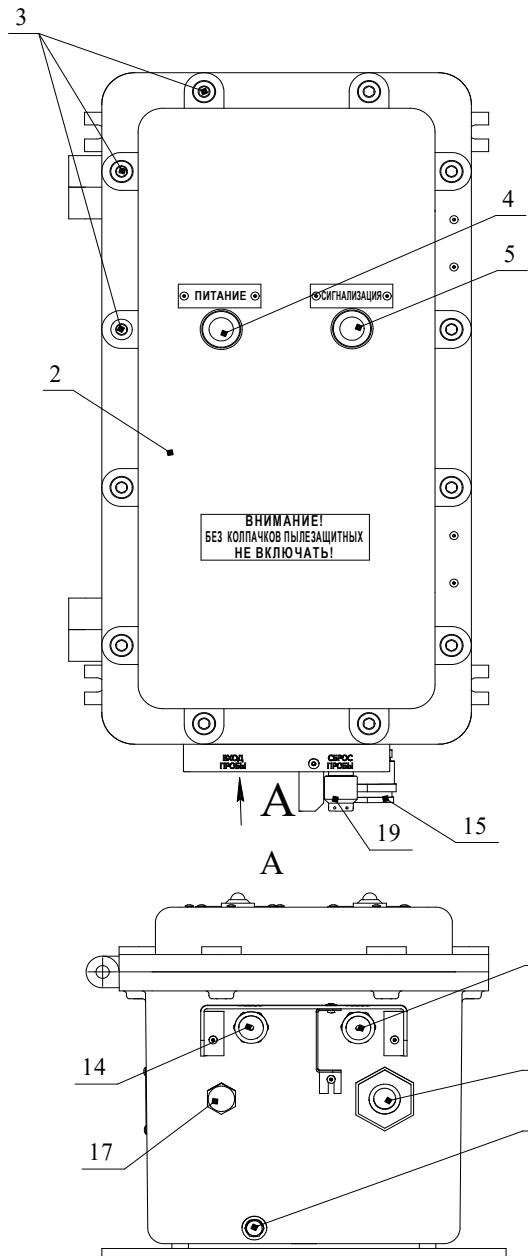

Внешний вид газоанализатора со снятой крышкой (поз.2)

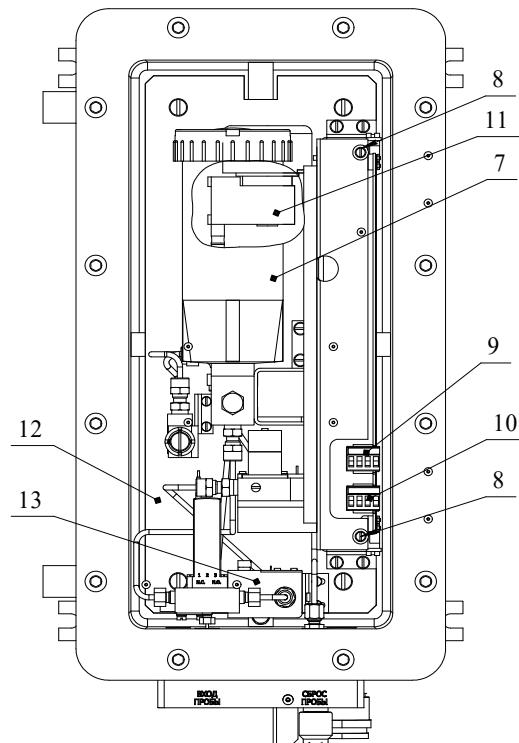

- 1 - корпус;
- 2 - крышка;
- 3 - винты с внутренним шестигранником для крепления крышки (поз. 2) к корпусу (поз.1);
- 4 - лампа индикационная зеленая "ПИТАНИЕ";
- 5 - лампа индикационная красная "СИГНАЛИЗАЦИЯ";
- 6 - табличка фирменная;
- 7 - фильтр поглотитель;
- 8 - место пломбирования;
- 9 - штекерная часть с винтовыми зажимами для подключения кабеля связи с ВУ по интерфейсу RS485, токовый выход;
- 10 - штекерная часть с винтовыми зажимами для подключения кабеля питания;
- 11 - побудитель расхода;
- 12 - блок аналитический;
- 13 - ячейка электрохимическая;
- 14 - штуцер "ВХОД ПРОБЫ";
- 15 - ввод кабельный для бронированных кабелей;
- 16 - штуцер "СБРОС ПРОБЫ";
- 17 - клапан дренажный;
- 18 - болт рабочего заземления (M6);
- 19 - колпачок пылезащитный.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ ПЫЛЕЗАЩИТНЫХ (ПОЗ.19)!

Рисунок 1.1 - Датчики-газоанализаторы паров КРТ ДАРТ ИБЯЛ.413411.054-02. Внешний вид

1.4.3 Работа газоанализаторов

1.4.3.1 Работа газоанализатора поясняется при помощи схемы пневматической принципиальной, приведенной на рисунке 1.2.

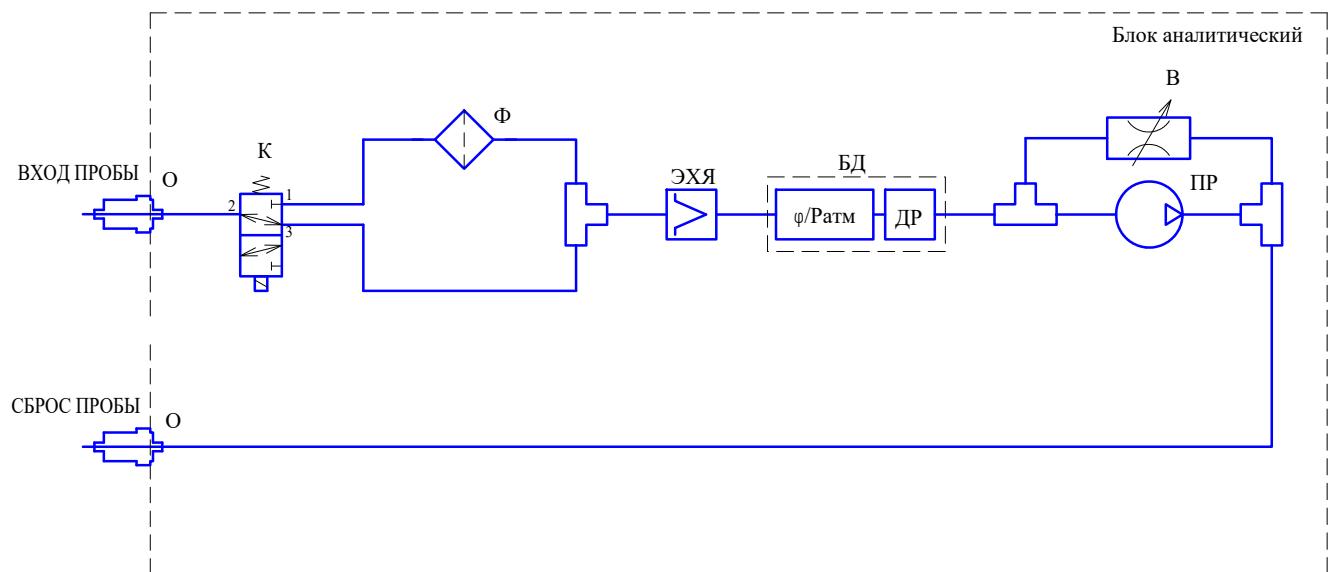


Рисунок 1.2 - Схема пневматическая принципиальная

1.4.3.2 Побудитель расхода (ПР) осуществляет непрерывный отбор пробы из анализируемой среды и прокачивает анализируемую пробу через газовый канал газоанализатора. Производительность побудителя расхода составляет от 0,5 до 1,0 дм³/мин.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПРОБЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЙПАСНОЙ ЛИНИИ С ВЕНТИЛЕМ (В) НА ВХОДЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА!

Клапан (К) предназначен для создания газовой модуляции потока анализируемой пробы, подавая пробу на ЭХЯ или через фильтр поглотитель (Ф), или минуя его.

При прохождении пробы через фильтр поглотитель, из пробы удаляются пары гидразин-гидрата, который химически связывается оксидом меди – наполнителем фильтра поглотителя.

При пропускании пробы через ЭХЯ, пары гидразин-гидрата, содержащиеся в пробе, электрохимически окисляются на поверхности рабочего электрода ячейки. Электрический ток, который возникает при электрохимическом окислении, пропорционален содержанию паров в пробе.

Блок датчиков (БД) состоит из датчика расхода (ДР) и датчика влажности и давления (φ/Ратм.), предназначенного для контроля расхода, создаваемого побудителем, и коррекции показаний газоанализатора от влияния параметров пробы.

При подаче на ЭХЯ пробы, из которой удалены пары гидразин-гидрата, газоанализатор регистрирует «нулевой» ток ЭХЯ. Благодаря газовой модуляции газоанализатор имеет возможность измерять очень малые концентрации, так как при каждом переключении потока пробы газоанализатор учитывает изменение тока ЭХЯ, вызванное такими факторами внешней среды, как температура, давление, влажность и содержание неопределяемых компонентов. Такой режим работы исключает необходимость периодической корректировки «нулевых» показаний газоанализатора.

Фильтр поглотитель является сменным элементом. Срок его службы зависит от содержания паров гидразин-гидрата в окружающей среде. Срок замены фильтра поглотителя не реже одного раза в год.

Управление режимами работы газоанализаторов осуществляется по цифровому каналу связи, перечень команд протокола приведен в приложении Б.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1 Для обслуживания газоанализаторов в процессе эксплуатации в состав поставки включены следующие комплекты:

- запасных частей ИБЯЛ.413943.045 (КЗЧ);
- инструмента и принадлежностей ИБЯЛ.413944.064-01 (КИП).

1.5.2 Перечень запасных частей, инструмента, принадлежностей, входящих в комплекты КЗЧ и КИП, применяемых при проведении технического обслуживания и текущего ремонта, приведен в таблице 1.5.

Т а б л и ц а 1.5

Обозначение	Наименование	Кол.	Место-нахождение	Применение
ИБЯЛ.418312.119	Фильтр сменный	1 шт.	КЗЧ	Периодическая замена фильтра поглотителя
	Ключ рожковый 5.5x7	1 шт.	КИП	Техническое обслуживание (для гаек М3, М4)
	Ключ рожковый 22x24	1 шт.	КИП	При монтаже газоанализатора (для кабельного ввода)
	Ключ разводной КР-19	1 шт.	КИП	Монтаж/ демонтаж фитинговых соединений при замене ЭХЯ
	Ключ разводной КР-30	1 шт.	КИП	
	Ключ рожковый 10x11	1 шт.	КИП	
	Ключ рожковый 8x10	1 шт.	КИП	
	Ключ шестигранный S6	1 шт.	КИП	Откручивание/закручивание винтов с внутренним шестигранником для открывания/закрывания крышки корпуса
	Отвертка шлицевая 100x5	1 шт.	КИП	Подключение/отключение жил кабеля питания и связи к клеммным колодкам
	Отвертка крестовая №3, 150 мм			Замена ЭХЯ
ИБЯЛ.764439.002	Ключ	1 шт.	КИП	Периодическая замена фильтра поглотителя
ИБЯЛ.431212.020-01	Диск с сервисным ПО	1 шт.	КИП	Подготовка газоанализатора к работе, поверка

Продолжение таблицы 1.5

Обозначение	Наименование	Кол.	Место-нахождение	Применение
ИБЯЛ.711111.162	Вставка	2 шт.	КИП	Отбор пробы непосредственно в точке установки газоанализатора
	Комплект колец уплотнительных для кабельного ввода FAL1BK	1 компл.	КИП	Монтаж/ демонтаж кабельного ввода
	Трубка Ф-4Д, 4,0x1,0 ГОСТ 22056—76	2 м	КИП	Сборка схемы корректировки показаний, периодическая поверка газоанализатора
ИБЯЛ.754175.017-03	Кольцо	5 шт.	КЗЧ	Периодическая замена фильтра поглотителя, в случае повреждения кольца
	ПГ- смазка в банке	60 г	КИП	Для защиты корпуса от коррозии и обеспечения степени защиты IP65

1.5.3 Изготовитель по отдельному договору поставляет:

- ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.125-01;
- фильтр поглотитель паров гидразин-гидрата (фильтр сменный ИБЯЛ.418312.119);
- преобразователь USB/RS485 Bolid..

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка газоанализаторов соответствует ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 26828-86, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 и чертежам изготовителя.

1.6.2 Маркировка газоанализаторов содержит следующие сведения:

- товарный знак изготовителя;
- условное наименование газоанализаторов;
- условное обозначение рода тока, номинальные значения напряжения питания;
- значение потребляемой мощности;
- вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
- диапазон рабочей температуры;
- химическую формулу определяемого компонента;
- диапазон измерений и единицу физической величины;
- пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- знак утверждения типа средства измерений;
- символ № 14 (Внимание, опасность) по ГОСТ 12.2.091-2012, свидетельствующий о необходимости изучения эксплуатационной документации перед началом работы;
- символ № 5 (Клемма заземления (земля)) по ГОСТ 12.2.091-2012 возле болта рабочего заземления;
- код KKS согласно проекту (только для газоанализаторов, поставляемых для атомных станций);
- квалификационное обозначение - 4 по НП 001-15 (только для газоанализаторов, поставляемых для атомных станций);
- заводской порядковый номер в формате YYXXXX, где YY – две последние цифры года изготовления, XXXX – порядковый номер газоанализатора в году;
- ИБЯЛ.413411.054 ТУ1;
- надписи или обозначения, указывающие назначение органов индикации, портов для подключения электрических и пневматических линий.

1.6.3 Шрифты и символы, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80 и чертежам изготовителя.

1.6.4 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

1.6.5 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192—96, чертежам изготовителя, и имеет манипуляционные знаки: «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ».

1.6.6 Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару.

1.6.7 Транспортная маркировка содержит:

а) основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;

б) дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;

в) значение минимальной температуры транспортирования - минус 30 °C;

г) дату отгрузки;

д) код KKS (при наличии).

1.6.8 Схема пломбировки газоанализаторов от несанкционированного доступа приведена в приложении В.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка проводится для условий транспортирования и хранения группы 3 (Ж3) по ГОСТ 15150—69.

1.7.2 Способ упаковки, транспортная тара, материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют чертежам изготовителя.

Упаковка соответствует категории КУ-3 по ГОСТ 23170—78.

Газоанализаторы подвергнуты консервации в соответствии с ГОСТ 9.014—78 для группы III-1.

Вариант временной внутренней упаковки ВУ-5, вариант защиты ВЗ-10.

Срок защиты без переконсервации – 3 года.

1.7.3 Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб на газоанализаторах.

1.7.4 Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от 15 до 40 °С, относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С и содержанием в воздухе коррозионных агентов, не превышающим установленного для атмосферы типа I по ГОСТ 15150—69.

1.7.5 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами изготовителя.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания по эксплуатации

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЛИ ПЛОМБАМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ В УСЛОВИЯХ И РЕЖИМАХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РЭ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ БЕЗ КОЛПАЧКОВ ПЫЛЕЗАЩИТНЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ШТУЦЕРЫ «ВХОД ПРОБЫ» И «СБРОС ПРОБЫ»!

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЙ!

2.1.1 По способу защиты персонала от поражения электрическим током газоанализаторы относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 Монтаж и подключение газоанализаторов проводятся при отключенном электропитании.

2.1.3 Оперативное обслуживание газоанализаторов осуществляется специалистами, изучившими эксплуатационную документацию, знающими правила эксплуатации электроустановок, сдавшими экзамены по технике безопасности и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.1.4 Работы по ремонту газоанализаторов должны проводиться только после отключения электропитания с обязательным вывешиванием в местах отключения предупредительных знаков согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001.

2.1.5 При эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соблюдаться требования «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536, и НП-044-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2018 № 93.

2.1.6 Монтаж газоанализаторов при строительстве нового объекта, реконструкции или ремонте существующего следует проводить как можно ближе к окончанию строительных работ, но до того, как станет возможно появление взрывоопасных газов, с тем, чтобы предотвратить повреждение газоанализаторов вследствие проведения таких работ, как сварка или покраска.

Если газоанализаторы уже смонтированы на месте установки, необходимо защитить их от загрязнения, возможного при проведении строительных работ, с помощью герметичного

материала, а также следует снабдить их четкой маркировкой, предупреждающей, что газоанализаторы отключены.

2.1.7 Газоанализаторы следует устанавливать в местах, которые обеспечивают соответствие температуры эксплуатации значениям, установленным изготовителем.

Не допускается эксплуатация газоанализаторов за границами диапазона значений рабочей температуры, установленного изготовителем.

2.1.8 При выборе места размещения необходимо учитывать, что газоанализаторы должны быть легкодоступными для проведения проверки выполнения требований электробезопасности.

Должна быть обеспечена возможность подключения к газоанализаторам приспособлений и контрольно-измерительного оборудования для проведения указанных работ на месте их установки.

2.1.9 ПГС при проверке газоанализаторов сбрасывать за пределы помещения или в газоход.

2.1.10 Требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок должны выполняться согласно СТО 1.1.1.02.001.0673-2017 «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП Концерн «Росэнергоатом».

2.1.11 Условия, срочность работы или другие причины не являются основанием для нарушения правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ ЗАЩИТА, ПРИМЕНЕННАЯ В ДАННОМ ОБОРУДОВАНИИ!

2.2 Подготовка газоанализаторов к использованию

2.2.1 Подготовка газоанализаторов к использованию включает в себя следующие основные операции:

- распаковывание и проверка комплектности;
- внешний осмотр;
- размещение и монтаж газоанализаторов;
- заземление газоанализаторов;
- подключение электрических цепей;
- корректировка чувствительности газоанализатора;
- установка пороговых значений срабатывания световой сигнализации;
- установка значения адреса газоанализаторов в информационной сети для цифрового канала связи RS485;
- проверка работоспособности газоанализаторов.

2.2.2 Распаковывание и проверка комплектности

2.2.2.1 Перед распаковыванием необходимо выдержать газоанализатор в упаковке в нормальных условиях в течение 6 ч. Если газоанализатор при транспортировке и хранении подвергался воздействию отрицательных температур, необходимо выдержать его в упаковке в нормальных условиях в течение 24 ч, после этого распаковать.

2.2.2.2 Проверить комплектность газоанализатора и комплектность ЗИП путем внешнего осмотра и сличением комплектности ЗИП с указанной в ИБЯЛ.413411.054-01 ЗИ.

2.2.2.3 Проверить комплектность эксплуатационной документации путем сличения комплектности эксплуатационных документов с указанной в ИБЯЛ.413411.054 ВЭ.

2.2.3 Внешний осмотр

2.2.3.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие повреждений, которые могут повлиять на степень защиты газоанализаторов, их взрывозащищенность и работоспособность;
- наличие всех крепежных и уплотнительных элементов, все крепежные элементы должны быть равномерно и плотно затянуты;
- наличие и целостность маркировки взрывозащиты, предупредительных надписей;
- наличие и целостность пломб (пломбы должны иметь четкий оттиск клейма).

2.2.4 Размещение и монтаж газоанализаторов

2.2.4.1 Выбор места размещения осуществляется проектная организация, определяя зону контроля на основании анализа возможных мест появления утечек паров гидразин-гидрата и анализа потенциальных рисков для персонала контролируемого объекта.

Дополнительными требованиями по размещению газоанализатора являются:

- газоанализатор должен быть размещен на жесткой вертикальной поверхности;
- несущая способность конструкции или стены, на которой размещен газоанализатор, должна выдерживать его массу без разрушения и деформации;
- газоанализатор следует устанавливать в местах, которые обеспечивают соответствие температуры эксплуатации значениям, установленным изготовителем;
- при выборе места размещения необходимо учитывать, что газоанализатор должен быть легкодоступным для проведения периодического технического обслуживания и для проверки выполнения требований электробезопасности;
- при выборе места размещения должна быть обеспечена возможность подключения к газоанализатору приспособлений и контрольно-измерительного оборудования для проведения технического обслуживания.

Место размещения должно быть размечено под установочные дюбели или болты (M8) в соответствии с монтажным чертежом, который приведен в приложении А.

2.2.5 Заземление газоанализаторов

2.2.5.1 Корпус газоанализатора должен быть заземлен при помощи наружного болта рабочего заземления M6 (см. рисунок 1.1 поз. 18).

Наружный заземляющий проводник должен быть тщательно защищен, а соединение его с зажимом заземления должно быть предохранено от коррозии посредством нанесения консистентной смазки.

По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего устройства, сопротивление должно быть не более 4 Ом.

2.2.6 Подключение электрических цепей

2.2.6.1 Подключение кабеля проводится после монтажа газоанализатора по месту его установки.

2.2.6.2 Для подключения газоанализатора к ВУ и источнику питания рекомендуется использовать кабели с медными жилами следующих марок:

- если регистрация показаний газоанализатора осуществляется только по выходному сигналу постоянного тока (4 – 20) мА, - кабель марки КВВГЭ 4x1,0, КВВГЭ 4x1,5 ГОСТ 1508—78. Допускается использование других марок кабелей с аналогичными характеристиками.

Минимальный наружный диаметр кабеля - 6,0 мм, максимальный - 12 мм;

- если регистрация показаний газоанализатора осуществляется по цифровому каналу связи или по выходному сигналу постоянного тока (4 – 20) мА, - кабель марки КИПвЭВБВ (КИПвЭВБВт, КИПвЭВБВм) 2×2×0,78 ТУ 16.К99–008–2001.

Длину кабеля между газоанализатором и источником питания (ВУ, ПЭВМ) следует выбирать в зависимости от площади поперечного сечения жил кабеля и значения напряжения на выходе источника питания.

На рисунке 2 приведена типовая зависимость максимально допустимой длины (L) кабеля между газоанализатором и источником питания от напряжения (U) на выходе источника питания и площади поперечного сечения жилы кабеля (S) для диапазона температуры окружающей среды от 1 до 45 °С.

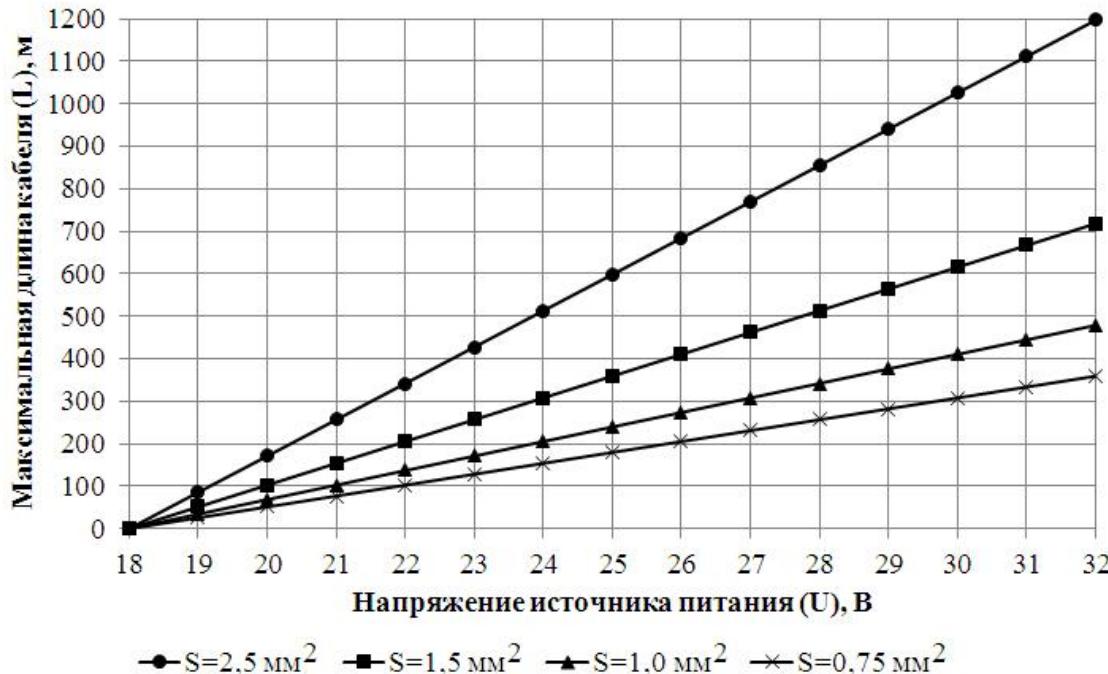


Рисунок 2 – Типовая зависимость максимально допустимой длины кабеля между газоанализатором и источником питания

2.2.6.3 Условия прокладки кабелей, в частности необходимость их дополнительной защиты от грызунов, прямых солнечных лучей, механических нагрузок, должны соответствовать требованиям изготовителя кабельной продукции.

2.2.6.4 Монтаж и подключение электрических цепей газоанализатора проводить, руководствуясь приложением А.

ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УСТРАНЯЮЩИХ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ГАЗОАНАЛИЗАТОР (ОСТ 11.073.062-2001 ПП. 4.3, 4.4.1, 4.5, 5.2)!

2.2.6.5 Подключение кабеля питания и связи проводить в следующей последовательности:

- открыть крышку газоанализатора (см. рисунок 1.1 поз. 2);
- снять наружный слой изоляции кабеля на (400 – 450) мм;
- разделать концы подводимого кабеля на отдельные жилы длиной (45 – 50) мм. Отдельные жилы кабеля, изготовленные из многожильного провода, должны быть опрессованы медной втулкой с внешним диаметром не более 2,5 мм (СП 77.13330.2016);
- надеть на жилы кабеля маркировочные бирки (не требуется, если в кабеле применена цветовая кодировка изоляции отдельных жил);
- края оболочки кабеля после разделки должны быть без продольных разрезов и разрывов длиной более 5 мм;
- продеть кабель сквозь кабельный ввод (см. рисунок 1.1 поз. 15), внешний край изоляции кабеля должен выступать из кабельного ввода на (5 – 10) мм;

- предварительно разделанные концы кабеля подключить к контактам клеммной колодки, при подключении руководствоваться назначением контактов, которое указано в приложении А;
- дренажный проводник экранной оплетки кабеля (экран) подключить к внутреннему зажиму рабочего заземления;
- при помощи ключа рожкового 22x24 прочно зафиксировать кабель по изоляционной оболочке первой и второй зажимной гайкой кабельного ввода;
- закрыть крышку корпуса, плотно затянуть все винты крышки при помощи шестигранника. При закрытии крышки последовательно, начиная от средних, затянуть крепежные винты крышки (см. рисунок 2.1). Затянуть крепежные винты до упора.

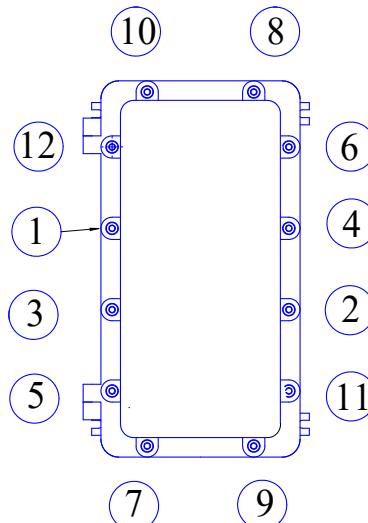


Рисунок 2.1 – Порядок закручивания винтов крышки газоанализатора (вид спереди).

ВНИМАНИЕ:

1 ПРИ ОТКРЫВАНИИ И ЗАКРЫВАНИИ КРЫШКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАННОСТЬ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ!

2 ПЕРЕД ЗАКРЫВАНИЕМ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПОВЕРХНОСТИ БЯЗЬЮ ИЛИ ВЕТОШЬЮ, СМОЧЕННОЙ В ЭТИЛОВОМ ИЛИ ИЗОПРОПИЛОВОМ СПИРТЕ, НАНЕСТИ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ CRV-Si ИЗ КИП!

2.2.6.6 Для защиты от попадания в газовый канал частиц, затрудняющих работу побудителя расхода и переключающего клапана, на штуцера «СБРОС ПРОБЫ» (см. рисунок 1.1. поз. 16) и «ВХОД ПРОБЫ» (см. рисунок 1.1 поз. 14) должны быть установлены колпачки пылезащитные (см. рисунок 1.1 поз. 19).

2.2.7 Корректировка чувствительности газоанализаторов

2.2.7.1 Провести корректировку чувствительности газоанализатора в соответствии с разделом 3 (см. п. 3.3.1).

П р и м е ч а н и е – Корректировка нулевых показаний газоанализатора не проводится.

2.2.8 Установка пороговых значений срабатывания световой сигнализации

2.2.8.1 При выпуске из производства в газоанализаторе установлены следующие пороговые значения срабатывания световой сигнализации:

- ПОРОГ1, равное $0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$ (1 ПДК);
- ПОРОГ2, равное $0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$ (5 ПДК).

2.2.8.2 При необходимости пользователь может изменить пороговые значения срабатывания световой сигнализации. Ввод новых значений проводится как при помощи

сервисного ПО, так и непосредственно по цифровому каналу связи в соответствии с приложением Б.

2.2.9 Установка значения адреса газоанализаторов в информационной сети для цифрового канала связи RS485

2.2.9.1 Для работы газоанализатора в сети сбора информации газоанализатору необходимо присвоить уникальный сетевой адрес.

В газоанализаторе при выпуске из производства устанавливается сетевой адрес № 1.

При необходимости, требуемое значение сетевого адреса устанавливается во вкладке «Сетевой адрес» сервисного ПО. Газоанализатор поддерживает диапазон сетевых адресов от 1 до 128.

2.2.10 Проверка работоспособности газоанализаторов

2.2.10.1 Проверку провести в следующей последовательности:

- газоанализатор установить в рабочее положение;
- собрать схему проверки работоспособности в соответствии с рисунком 2.2;
- газоанализатор включить, прогреть;
- запустить сервисное ПО на ПЭВМ;
- зарегистрировать соответствие показаний миллиамперметра значениям, индицируемым в окне сервисного ПО.

Газоанализатор ДАРТ

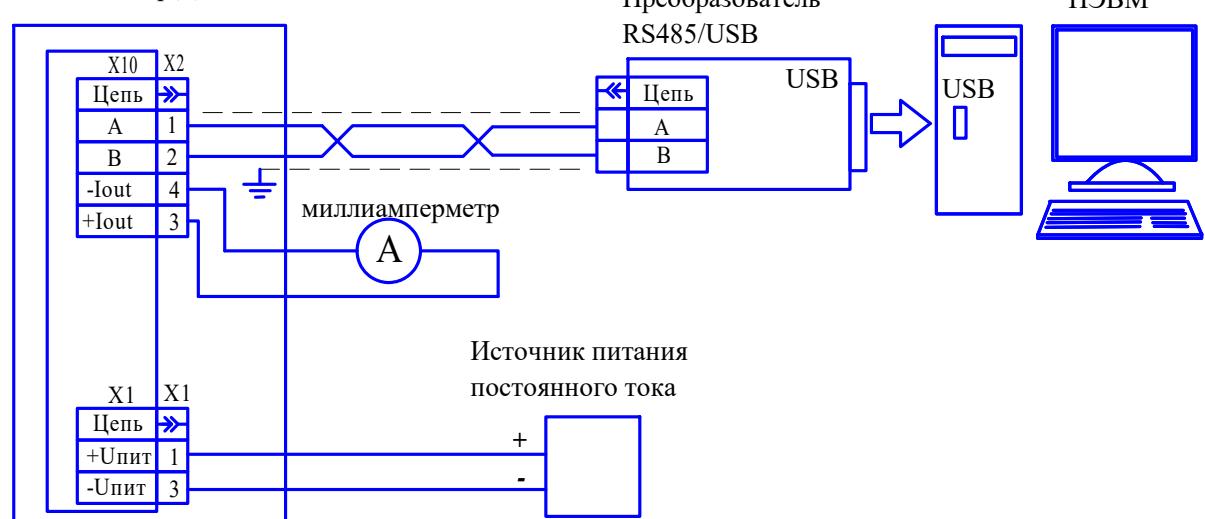


Рисунок 2.2 - Схема проверки работоспособности газоанализаторов

2.3 Использование газоанализаторов

2.3.1 Порядок работы

2.3.1.1 Газоанализаторы по окончании времени прогрева осуществляют непрерывное автоматическое измерение массовой концентрации паров гидразин-гидрата в воздухе и выдачу сигнализации об увеличении показаний относительно установленных пороговых значений.

2.3.1.2 При превышении массовой концентрации паров гидразин-гидрата установленного порогового значения ПОРОГ1 происходит срабатывание сигнализации ПОРОГ1, при этом включается прерывистая световая индикация красного цвета СИГНАЛИЗАЦИЯ (частотой от 0,5 до 1 Гц).

2.3.1.3 При превышении массовой концентрации паров гидразин-гидрата установленного порогового значения ПОРОГ2 происходит срабатывание сигнализации ПОРОГ2, при этом включается прерывистая световая индикация красного цвета СИГНАЛИЗАЦИЯ с повышенной частотой от 5 до 7 Гц.

2.3.1.4 Работа газоанализатора по цифровому каналу связи

2.3.1.4.1 Газоанализаторы имеют цифровой канал связи с ВУ.

Перечень команд протокола MODBUS RTU, поддерживаемого газоанализатором, приведен в приложении Б.

Для работы газоанализатора с ПЭВМ в комплект поставки входит сервисное ПО.

2.3.1.5 Работа с сервисным ПО

2.3.1.5.1 Сервисное ПО поставляется на носителе, содержащем установочный модуль ПО «setup.exe».

Перед началом работы с сервисным ПО обязательно ознакомьтесь с содержимым файла «help.pdf», расположенным на DVD-диске

2.3.1.5.2 Сервисное ПО выполняет следующие функции:

- запрос и вывод на экран ПЭВМ следующих параметров:
 - а) измеренного значения содержания определяемого компонента;
 - б) сообщения о неисправностях газоанализатора;
 - в) идентификационных данных встроенного ПО;
- установка пороговых значений включения световой сигнализации;
- установка сетевого адреса;
- корректировка чувствительности газоанализатора.

2.3.1.5.3 Требования к ПЭВМ для установки сервисного ПО:

- процессор с тактовой частотой не менее 800 МГц;
- объем оперативной памяти не менее 512 Мб;
- свободное пространство на жестком диске, не менее 10 Мб;
- разрешение экрана не менее 800×600;
- наличие привода DVD-ROM;
- операционная система – Windows XP SP3 и выше;

- наличие порта USB.

2.3.1.5.4 Для подключения газоанализатора к ПЭВМ необходимо:

- собрать схему, приведенную на рисунке 2.3;
- включить питание газоанализатора и ПЭВМ;
- запустить на ПЭВМ программу «DART.exe».

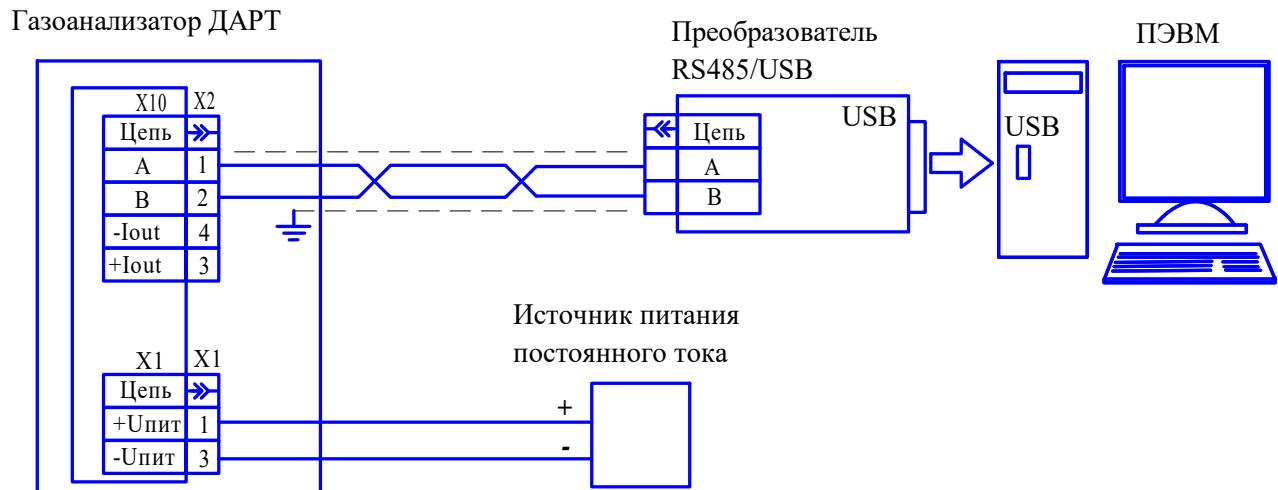


Рисунок 2.3 - Схема подключения газоанализатора к ПЭВМ

2.3.1.6 Проверка идентификационных данных ПО

2.3.1.6.1 Для проверки идентификационных данных ПО необходимо:

- подключить газоанализатор к ПЭВМ и запустить на ПЭВМ программу «DART.exe» (см. п. 2.3.1.5.4);
- нажать кнопку «Запустить опрос параметров»;
- проконтролировать во вкладке «Опрос параметров» появление номера версии и контрольной суммы ПО напротив соответствующих строк.
- проверить соответствие данных, выводимых на экране ПЭВМ, данным, приведенным в таблице 1.3.

2.3.1.7 Работа сервисного ПО в сети сбора данных

2.3.1.7.1 Сервисное ПО имеет возможность сбора данных с нескольких газоанализаторов, включенных в общую информационную сеть. Для этого необходимо в поле «Адреса устройств» внести необходимые адреса газоанализаторов, установить галочку напротив соответствующих газоанализаторов и нажать кнопку «Запустить опрос».

2.3.1.7.2 Информация о работе с сервисным ПО содержится в меню «Справка».

П р и м е ч а н и е – Для работы в меню «Справка» необходима установка программного продукта Adobe Acrobat 8.

2.3.1.8 Потребление газоанализаторов

2.3.1.8.1 Типовая зависимость тока потребления газоанализатора от напряжения питания приведена на рисунке 2.4.

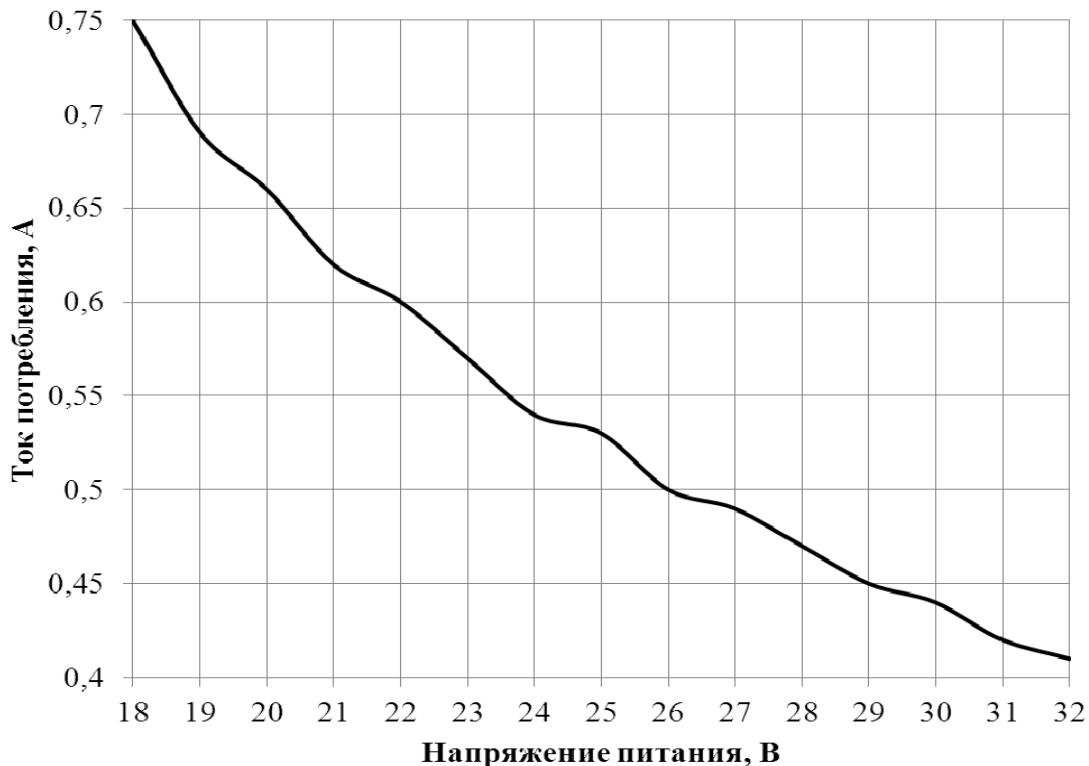


Рисунок 2.4 – Типовая зависимость тока потребления газоанализатора от напряжения питания

П р и м е ч а н и е – Максимальный пусковой ток при напряжении питания, равном 32 В, составляет от 7 до 8 А при длительности импульса тока не более 200 мкс.

2.3.2 Методика измерений

2.3.2.1 Метод измерений – прямые измерения массовой концентрации паров гидразин-гидрата (ГОСТ 19503-88) в воздухе.

2.3.2.2 Подготовить газоанализатор к работе в соответствии с п. 2.2 настоящего РЭ. Прогреть газоанализатор.

2.3.2.3 Зарегистрировать результаты измерений спустя 5 мин после окончания времени прогрева газоанализатора по значениям выходного сигнала постоянного тока по миллиамперметру или по цифровому каналу связи на экране ПЭВМ.

2.3.3 Возможные неисправности и способы их устранения

2.3.3.1 Возможные неисправности газоанализаторов и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Внешний признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1 Отсутствует индикация ПИТАНИЕ	Обрыв кабеля питания и связи	Устранить обрыв
2 Отсутствует или нестабилен выходной сигнал постоянного тока газоанализатора	Напряжение питания газоанализатора не соответствует диапазону допускаемых значений	Проверить соответствие значения питающего напряжения на клеммах X1:1 и X1:3 газоанализатора допустимому диапазону.
3 Непрерывное свечение лампы СИГНАЛИЗАЦИЯ, выдача фиксированного значения тока $(2,0 \pm 0,2)$ мА в линию выходного сигнала постоянного тока и/или сообщения «Отказ побудителя расхода» в окне сервисного ПО	Загрязнены колпачки пылезащитные	Выполнить очистку колпачков пылезащитных по методике п. 3.3.6
	Неисправен побудитель расхода	Ремонт на предприятии-изготовителе
4 Непрерывное свечение лампы СИГНАЛИЗАЦИЯ, выдача фиксированного значения тока $(1,0 \pm 0,2)$ мА в линию выходного сигнала постоянного тока и/или сообщения «Отказ ЭХЯ» в окне сервисного ПО	Неисправна ЭХЯ	Замена ЭХЯ по методике п. 4.4.1
<p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Во всех остальных случаях ремонт производится изготовителем или в специализированных сервисных центрах. Список сервисных центров приведен на сайтах изготовителя: www.analitpribor-smolensk.ru и analitpribor.ru.</p> <p>2 Отправляемые в ремонт газоанализаторы должны быть очищены снаружи от загрязнений согласно п. 3.3.3.</p> <p>3 Газоанализаторы должны отправляться в ремонт комплектно (см. раздел 3 ИБЯЛ.413411.054 ФО2).</p>		

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Регламент проведения технического обслуживания и его объем

3.1.1 При использовании газоанализаторов по назначению и хранении следует проводить их техническое обслуживание (далее – ТО). Виды, объем, и периодичность ТО газоанализаторов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Вид ТО	Объем ТО	Периодичность
1 Корректировка чувствительности газоанализаторов по ПГС	п. 3.3.1	Один раз в 6 месяцев или при необходимости*
2 Контрольный осмотр	п. 3.3.2	По регламенту эксплуатирующей организации
3 Очистка корпуса от загрязнений	п. 3.3.3	Один раз в 6 месяцев или при необходимости
4 Дезактивация	п. 3.3.4	При необходимости
5 Замена фильтра поглотителя	п. 3.3.5	Один раз в 12 месяцев или при необходимости
6 Очистка колпачков пылезащитных	п. 3.3.6	Один раз в 3 месяца
7 Проверка работоспособности	п. 3.4	Перед вводом в эксплуатацию, при подготовке к периодической поверке
8 Техническое освидетельствование	п. 3.5	Один раз в 12 месяцев
9 Консервация (расконсервация, переконсервация)	п. 3.6	Переконсервация по истечении 3 лет хранения

* Корректировку чувствительности по ПГС следует также провести:

- при первом включении газоанализаторов после расконсервации и после получения газоанализаторов из ремонта, проводимого изготовителем;
- перед проведением поверки газоанализатора;
- в случае если возникают сомнения в достоверности показаний газоанализатора.

3.1.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.2.1 К проведению технического обслуживания газоанализаторов должны допускаться специалисты, изучившие материальную часть и эксплуатационную документацию на газоанализаторы и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок должны выполняться согласно СТО 1.1.1.02.001.0673-2017 «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП Концерн «Росэнергоатом».

3.2.2 При эксплуатации баллонов со сжатыми газами должны соблюдаться требования «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536, и НП-044-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.03.2018 № 93.

3.2.3 ПГС при проверке газоанализаторов сбрасывать за пределы помещения или в газоход.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УСТРАНЯЮЩИХ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ (ОСТ 11.073.062-2001 ПП.4.3, 4.4.1, 4.5, 5.2)!

3.3 Порядок технического обслуживания газоанализаторов

3.3.1 Корректировка чувствительности газоанализаторов по ПГС

3.3.1.1 Средства проведения корректировки чувствительности, расходные материалы приведены в таблице 3.2.

Т а б л и ц а 3.2

Средства проведения корректировки чувствительности		
Наименование	Кол.	Примечание
Барометр-анероид контрольный М67, диапазон измерений давления от 81,3 до 105,0 кПа (от 610 до 790 мм рт. ст.), погрешность $\pm 0,1$ кПа ($\pm 0,8$ мм рт. ст.); ТУ 25-04-1797-75	1 шт.	С газоанализатором не поставляется
Гигрометр психрометрический ВИТ-2, диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90 %, предел абсолютной погрешности от 5 до 7 %; диапазон измерений температуры от 15 до 40 °C, предел абсолютной погрешности $\pm 0,2$ °C; ТУ 25-11.1645-84	1 шт.	
Источник питания постоянного тока Б5-71/1ММ, диапазон измерений выходного напряжения от 0 до 50 В, диапазон измерений выходного тока от 0 до 10 А; ТУ 6688-001-75414802-2009	1 шт.	
Мультиметр В7-80, МЕРА.411189.001 ТУ, диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 5 А	1 шт.	
Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, емкость шкалы 60 с/60 мин, КТ 2; ТУ 25-1894.003-90	1 шт.	
Редуктор баллонный БКО-25-1, ТУ26-05-90-87	2 шт.	
Трубка ТС-Т (тройник) ГОСТ 25336—82	5 шт.	
Склейка СВТ ГОСТ 25336—82	7 шт.	
ПЭВМ ОС Windows XP/2000/98 с установленным Windows Framework 2.0; процессор не ниже 600 МГц; ОЗУ не менее 64 Мб; COM1-порт	1 шт.	
Программа «DART.exe»	1 шт.	
Термогигрометр электронный «CENTER» модели 311, диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, абсолютная погрешность $\pm 2,5$ %; диапазон измерений температур (внутренний датчик) от минус 20 до 60 °C, погрешность $\pm 0,7$ °C	1 шт.	
Генератор газовых смесей ГГС модификации ГГС-Р ШДЕК.418313.009 ТУ. Коэффициент разбавления от 2 до 2500; пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента разбавления $\pm (0,8 - 2,5)$ %; диапазон измерений и регулирования расходов от 2,00 до 5000 см ³ /мин; пределы относительной погрешности измерений расхода $\pm (0,5 - 1,5)$ %	2 шт.	

Продолжение таблицы 3.2

Средства проведения корректировки чувствительности		
Наименование	Кол.	Примечание
Счетчик газовый барабанный ГСБ-400, ТУ 25-04-2261-75 , относительная погрешность измерения расхода газа не более 1 %	1 шт.	С газоанализатором не поставляется
Термостат водяной «Экрос» или аналогичный с погрешностью поддержания температуры в пределах $\pm 0,2$ °C	1 шт.	
Ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ, кл.4, ГОСТ 13045-81	2 шт.	
Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы в соответствии с МИ 243/01-2016 (далее – МИ)		
Трубка Ф-4Д 4,0x1,0 ГОСТ 22056—76	2 м	КИП
Расходные материалы для проведения корректировки газоанализаторов		
Наименование	Кол.	Примечание
Поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух марка Б по ТУ 6-21-5-82 в баллонах под давлением	-	Поставляются поциальному заказу
Азот газообразный особой чистоты по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением	-	
Реактивы согласно разделу 3 МИ	-	
П р и м е ч а н и е - Допускается использование другого оборудования и средств измерений, обеспечивающих требуемую точность и пределы измерений		

3.3.1.2 Корректировку чувствительности газоанализаторов проводить при следующих условиях:

- температура окружающей среды (20 ± 5) °C;
- относительная влажность окружающей среды от 30 до 80 %;
- атмосферное давление $(101,3 \pm 4,0)$ кПа $((760 \pm 30)$ мм рт.ст.);
- напряжение питания постоянного тока (24 ± 1) В;
- механические воздействия, наличие пыли, агрессивных примесей, внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работу газоанализатора, должны отсутствовать.

Параметры анализируемых газовых смесей на входе газоанализатора:

- температура (20 ± 5) °C;
- относительная влажность (60 ± 3) %.

Характеристики ПГС, необходимой для проведения корректировки, приведены в приложении Г.

Напряжение в сети переменного тока от 198 до 242 В.

3.3.1.3 Перед проведением корректировки чувствительности должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- подготовить генераторы газовых смесей ГГС (модификация ГГС-Р) и прочие средства проведения корректировки чувствительности, указанные в таблице 3.2, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них;

- ПНГ должен быть выдержан в помещении, в котором проводится корректировка, в течение 24 ч, газоанализатор – в течение 2 ч;

- собрать газовую схему согласно рисунку 3.1(а) или 3.1(б), в зависимости от имеющихся в наличии материалов (гидразин-гидрат технический марки ННz-100 или источник микропотока паров ИМ гидразин-гидрата модификации ИМ-ГП-179-М-А2);

- включить приточно-вытяжную вентиляцию.

3.3.1.4 Показания газоанализатора регистрировать по значениям, индицируемым в окне сервисного ПО на экране ПЭВМ и по выходному сигналу постоянного тока.

3.3.1.5 Корректировку чувствительности газоанализатора проводить в следующей последовательности:

- газоанализатор включить, прогреть при непрерывной подаче ПГС № 1, затем временно отключить от газовых магистралей;

- создать ПГС № 3 в соответствии с МИ;

- подать ПГС № 3 на газоанализатор в течение 20 мин. Одновременно с подачей ПГС на газоанализатор выполнить отбор ПГС и определить действительное значение массовой концентрации гидразин-гидрата C_d , $\text{мг}/\text{м}^3$, в ПГС в соответствии с МИ;

П р и м е ч а н и е – При пропускании ПГС № 3 через газоанализатор регистрировать срабатывание сигнализации ПОРОГ2.

- откорректировать чувствительность газоанализатора, используя сервисное ПО. При корректировке показаний использовать действительное значение массовой концентрации гидразин-гидрата, определенное в соответствии с МИ;


- зарегистрировать значение выходного сигнала постоянного тока I_i , mA , и показания газоанализатора в окне сервисного ПО;

- рассчитать результат измерений содержания гидразин-гидрата C_i , массовая концентрация, $\text{мг}/\text{м}^3$, по значению выходного сигнала постоянного тока (4–20) mA по формуле

$$C_i = \frac{C_b}{16} \cdot (I_i - 4), \quad (3.1)$$

где I_i – установившееся значение выходного токового сигнала при подаче ПГС № 3, mA ;

C_b – значение содержания определяемого компонента, соответствующее верхней границе диапазона измерений, массовая концентрация, $\text{мг}/\text{м}^3$.

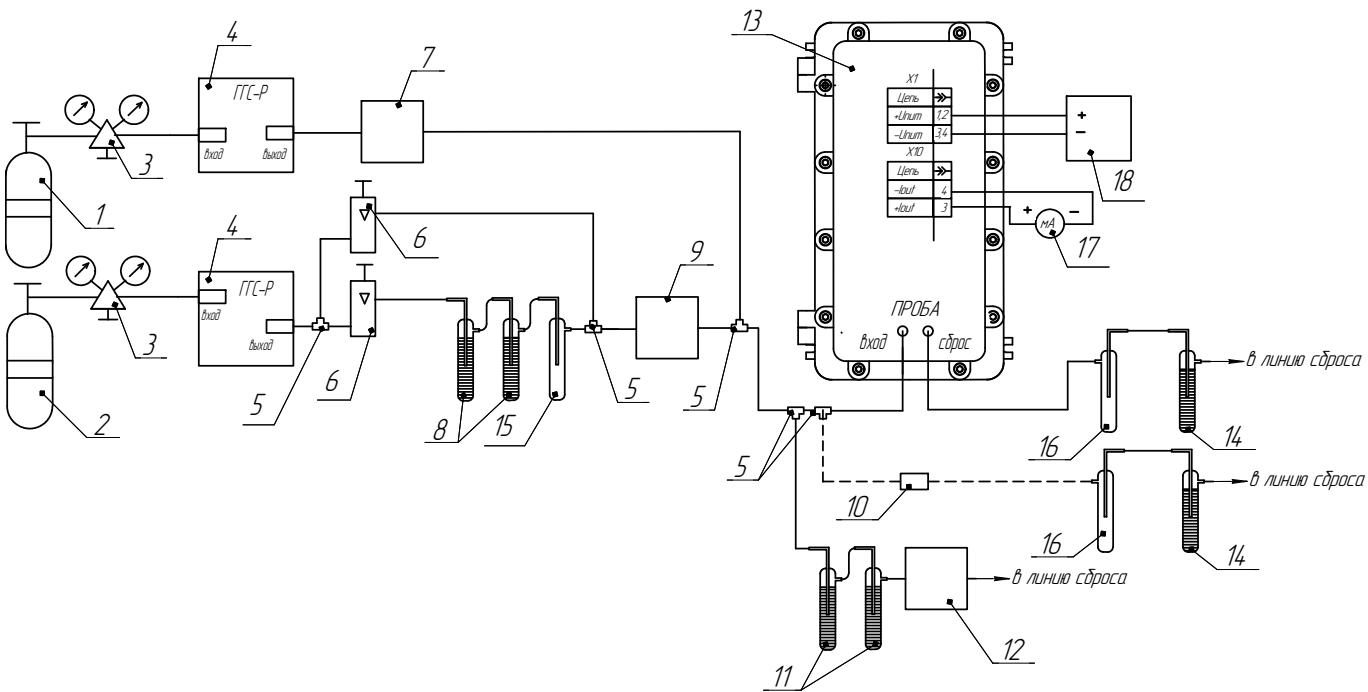

- 1 – баллон с азотом газообразным особой чистоты ГОСТ 9293-74;
 2 – баллон с воздухом марки Б ТУ 6-21-5-82; 3 – редуктор баллонный БКО-25-1;
 4 – генератор газовых смесей ГГС; 5 – тройник;
 6 – ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ; 7 – дозатор в термостате;
 8 – склянка СВТ с дистиллированной водой (объем воды в каждой склянке – (75 ± 25) мл);
 9 – термогигрометр электронный «CENTER» модели 311;
 10 – регулируемый зажим для трубок (зажим Гофмана винтовой);
 11 – поглотительный прибор Зайцева с поглотительным раствором;
 12 – счетчик газовый; 13 – газоанализатор;
 14 – склянка Дрекселя с насыщенным раствором хлорного железа;
 15 – склянка СВТ (каплеуловитель); 16 – склянка Дрекселя;
 17 – мультиметр В7-80 (в режиме измерения силы постоянного тока);
 18 – источник питания постоянного тока.


П р и м е ч а н и е – Участок от тройника (5), установленного перед регулируемым зажимом (10), до склянки Дрекселя (16) выполнить трубкой ПВХ 4x1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006.

Газовые соединения выполнить трубкой Ф-4Д 4,0x1,0.

ВНИМАНИЕ: ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ С ГИДРАЗИН-ГИДРАТОМ НЕОБХОДИМО СКЛЯНКИ С СОДЕРЖИМЫМ ОБРАБОТАТЬ ОЧИСТИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ Д!

а) схема для проведения корректировки чувствительности с использованием дозатора в термостате

Рисунок 3.1 – Схемы для проведения корректировки чувствительности

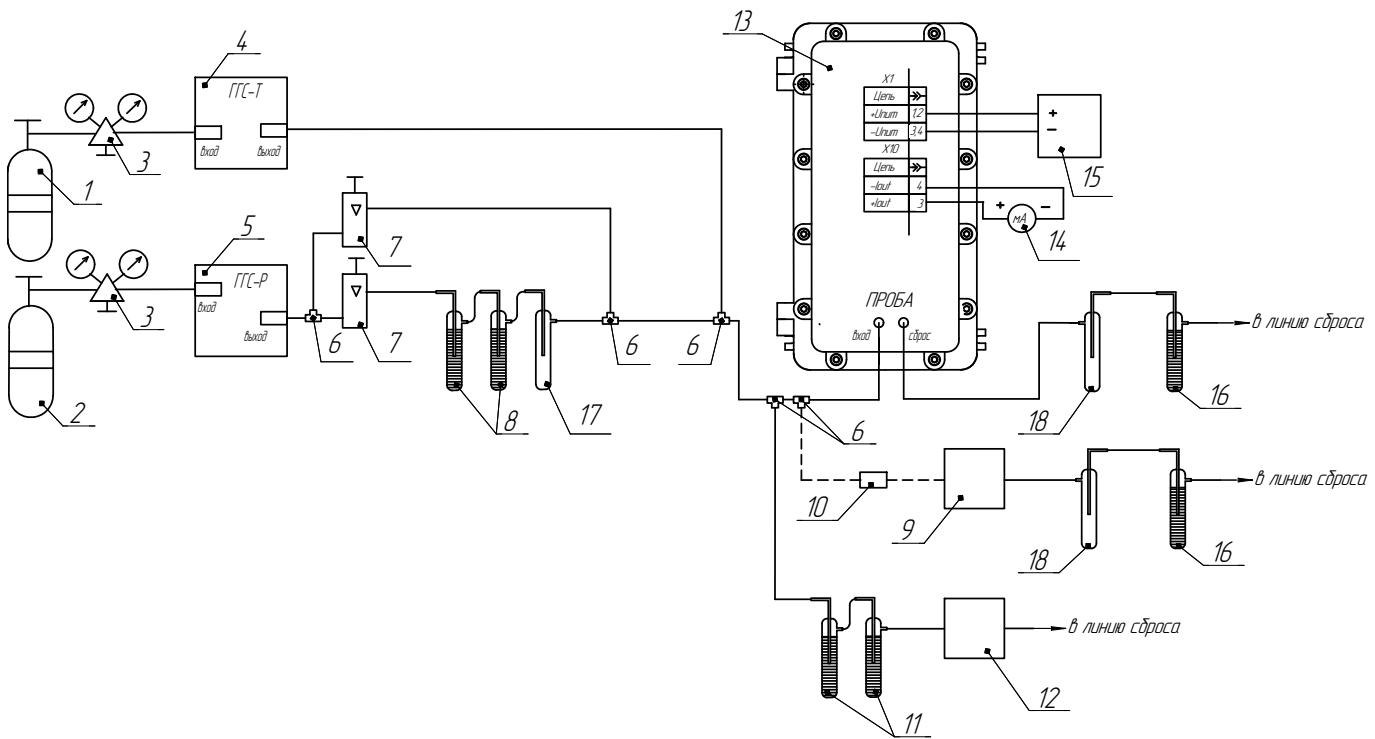

- 1 – баллон с азотом газообразным особой чистоты ГОСТ 9293-74;
 2 – баллон с ПНГ- воздух по ТУ 6-21-5-82; 3 – редуктор баллонный БКО-25-1;
 4 – генератор газовых смесей ГГС модификации ГГС-Т с ИМ гидразин-гидрата;
 5 – генератор газовых смесей ГГС модификации ГГС-Р; 6 – тройник;
 7 – ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ;
 8 – склянка СВТ с дистиллированной водой (объем воды в каждой склянке – (75 ± 25) мл);
 9 – термогигрометр электронный «CENTER» модели 311;
 10 – регулируемый зажим для трубок (зажим Гофмана винтовой);
 11 – поглотительный прибор Зайцева с поглотительным раствором; 12 – счетчик газовый;
 13 – газоанализатор; 14 – мультиметр В7-80 (в режиме измерения силы постоянного тока);
 15 – источник питания постоянного тока;
 16 – склянка Дрекселя с насыщенным раствором хлорного железа;
 17 – склянка СВТ (каплеуловитель); 18 – склянка Дрекселя.

П р и м е ч а н и е – Участок от тройника (6), установленного перед регулируемым зажимом (10), до термогигрометра (9) выполнить трубкой ПВХ 4x1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006.

Газовые соединения выполнить трубкой Ф-4Д 4,0x1,0.

ВНИМАНИЕ: ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ С ГИДРАЗИН-ГИДРАТОМ НЕОБХОДИМО СКЛЯНКИ С СОДЕРЖИМЫМ ОБРАБОТАТЬ ОЧИСТИТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ Д!

- б) схема для проведения корректировки чувствительности с использованием источника микропотока

Рисунок 3.1 (продолжение) – Схемы для проведения корректировки чувствительности

- вычислить значение основной относительной погрешности газоанализатора δ , %, по формуле:

$$\delta = ((C_i - C_d)/C_d) \cdot 100 \%, \quad (3.2)$$

где C_i – показания газоанализатора при подаче ПГС № 3, массовая концентрация, $\text{мг}/\text{м}^3$ (рассчитаны по формуле (3.1));

C_d – действительное значение содержания гидразин-гидрата в ПГС № 3, массовая концентрация, $\text{мг}/\text{м}^3$, определенное по МИ.

Если показания газоанализатора после проведения корректировки отличаются от действительного значения содержания гидразин-гидрата в ПГС № 3 более, чем на $\pm 0,2\delta_d$, то корректировку чувствительности необходимо повторить.

3.3.2 Контрольный осмотр

3.3.2.1 Провести внешний осмотр газоанализаторов по п. 2.2.3. Дополнительно проверить:

- состояние уплотнения кабеля в узле кабельного ввода;
- отсутствие повреждений оболочки кабелей на вводе;
- надёжность присоединения жил кабелей в клеммных колодках;
- состояние зажимов заземления (не должно быть следов ржавчины и окисления);
- чистоту колпачков пылезащитных.

3.3.3 Очистка корпуса от загрязнений

3.3.3.1 Расходные материалы для очистки корпуса газоанализаторов приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Наименование	Кол.	Примечание
Мыло хозяйственное твердое ГОСТ 30266-2017	0,05 кг	С газоанализаторами не поставляется
Бязь отбеленная ГОСТ 29298-2005	0,1 кг	

3.3.3.2 Очистку корпуса газоанализаторов от пыли и жировых загрязнений проводить влажной тряпкой. При этом исключить попадание влаги внутрь корпуса газоанализаторов.

Для удаления жировых загрязнений необходимо использовать моющие средства, не содержащие хлор и сульфаты (стиральные порошки, мыло). Рекомендуется использовать мыло детское, банное, хозяйственное.

3.3.4 Дезактивация

3.3.4.1 Дезактивация проводится только для газоанализаторов, поставляемых на атомную станцию. Необходимость и частота дезактивации наружных и внутренних поверхностей газоанализаторов устанавливаются в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на АЭС.

При проведении дезактивации должны быть соблюдены требования инструкций по охране труда при работе с кислотами и щелочами.

3.3.4.2 Средства проведения дезактивации и расходные материалы приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Средства проведения дезактивации газоанализаторов		
Наименование	Количество	Примечание
Ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУЗ, КТ 4, верхний предел 0,063 м ³ /ч; ГОСТ 13045-81	1 шт.	Поставляется поциальному заказу
Вентиль точной регулировки ВТР-2, ИБЯЛ.306577.002-04	1 шт.	Поставляется поциальному заказу
Трубка поливинилхлоридная гибкая 6x1,5, ТУ 2247-465-00208947-2006	5 м	В комплекте ЗИП
Стеклянные емкости для приготовления дезактивирующего раствора, объем не менее 2 л	4 шт.	С газоанализаторами не поставляется
Зажим кровоостанавливающий 1x2-зубый, зубчатый прямой ТУ6-1-3220-79	1 шт.	
Кисть малярная флейцевая (50 мм)	1 шт.	

Продолжение таблицы 3.4

Расходные материалы для проведения дезактивации газоанализаторов		
Наименование	Количество	Примечание
Гидроксид натрия (NaOH)	120 г	
Перманганат калия (KMnO ₄)	10 г	
Кислота щавелевая (H ₂ C ₂ O ₄)	80 г	
Спирт этиловый (C ₂ H ₅ OH)	2 л	
Вода дистиллированная	27 л	
Азот газообразный особой чистоты ГОСТ 9293—74	140 л	

3.3.4.3 Для дезактивации газоанализаторов необходимо:

- приготовить раствор для дезактивации наружных поверхностей узлов приборов при дезактивации помещений по СТО 1.1.1.07.001.0675-2017 в количестве 2 л каждого раствора:
 - а) раствор 1: едкий натр (NaOH) – (50 - 60) г/л; перманганат калия (KMnO₄) – (5 - 10) г/л;
 - б) раствор 2: щавелевая кислота (H₂C₂O₄) – (20 - 40) г/л;
- наружные поверхности газоанализатора дезактивировать путем промывки с помощью кисти:
 - а) раствором 2 в количестве 1 л;
 - б) дистиллированной водой в количестве 1 л;
 - в) раствором 1 в количестве 1 л;
 - г) дистиллированной водой в количестве 1 л;
 - д) спиртом этиловым в количестве 1 л;
- газовый канал газоанализаторов дезактивировать следующим образом:
 - а) перевернуть газоанализаторы на 180° вокруг своей оси, штуцерами вверх;
 - б) налить в стеклянные емкости растворы 1 и 2, спирт этиловый и дистиллированную воду. Растворы 1 и 2 должны быть подогреты до температуры 100 °C;
 - в) поочередно подсоединить стеклянные емкости с растворами, спиртом этиловым и дистиллированной водой к входу газоанализатора. Емкости должны находиться выше уровня расположения газоанализатора, чтобы обеспечить прохождение растворов через газовый канал газоанализатора самотеком. Протекание растворов регулировать с помощью медицинского зажима;
 - г) промыть газовый канал раствором 2 в количестве 1 л;
 - д) промыть газовый канал дистиллированной водой в количестве 1 л;
 - е) промыть газовый канал раствором 1 в количестве 1 л;
 - ж) промыть газовый канал дистиллированной водой в количестве 20 л;

з) продуть газовый канал сжатым воздухом с расходом $(0,7 \pm 0,2)$ $\text{дм}^3/\text{мин}$ в течение 15 мин;

и) промыть газовый канал спиртом этиловым в количестве 1 л;

к) продуть газовый канал сжатым воздухом с расходом $(0,7 \pm 0,2)$ $\text{дм}^3/\text{мин}$ в течение 2 ч.

3.3.4.4 После дезактивации газоанализаторы либо подлежат утилизации, либо должны быть отправлены на предприятие-изготовитель для восстановления газового канала.

3.3.5 Замена фильтра поглотителя

3.3.5.1 Периодичность замены фильтра поглотителя зависит от содержания паров гидразин-гидрата в анализируемой среде.

Замену фильтра поглотителя проводить в следующих случаях:

- периодическая замена – один раз в год;
- в процессе эксплуатации перед проведением периодической поверки;
- при появлении сомнений в достоверности показаний газоанализатора.

3.3.5.2 Инструменты и расходные материалы для замены фильтра поглотителя приведены в таблице 3.5.

Т а б л и ц а 3.5

Инструменты		
Наименование	Кол.	Примечание
Ключ ИБЯЛ.764439.002	1 шт.	КИП
Расходные материалы		
Наименование	Кол.	Примечание
Кольцо ИБЯЛ.754175.017-03	1 шт.	КЗЧ (при необходимости)
Фильтр сменный ИБЯЛ.418312.119	1 шт.	КЗЧ

3.3.5.3 Замену фильтра поглотителя проводить в следующем порядке:


- выключить питание газоанализатора;
- открутить винты (см. рисунок 1.1 поз. 3) и открыть крышку (см. рисунок 1.1 поз. 2);
- установить ключ ИБЯЛ.764439.002 на ребра жесткости фильтра поглотителя и, вращая против часовой стрелки, открутить фильтр поглотитель;
- извлечь фильтр поглотитель (фильтр сменный ИБЯЛ.418312.119) из КИП, установить его на место демонтированного фильтра.

П р и м е ч а н и е - В случае повреждения кольца, необходимо заменить его на новое из КЗЧ;

- закрыть крышку газоанализатора, соблюдая последовательность закручивания крепежных винтов, указанную в разделе 2;
- газоанализатор включить, прогреть.

3.3.6 Очистка колпачков пылезащитных

3.3.6.1 Очистка колпачков пылезащитных (далее - колпачки) проводится при снижении расхода газоанализатора. Внешний вид колпачков приведен на рисунке 3.2.

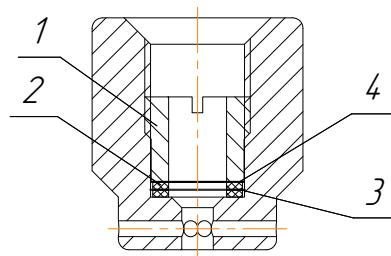

1 - втулка, 2 - прокладка; 3 - шайба; 4 - сетка

Рисунок 3.2 - Колпачок пылезащитный

3.3.6.2 Очистку колпачков проводить в следующей последовательности:

- отвинтить колпачки со штуцеров «ВХОД ПРОБЫ» и «СБРОС ПРОБЫ»;
- отвинтить втулку (1), извлечь шайбу (3), прокладку (2) и сетку (4);
- продуть сетку (4) сжатым воздухом;
- установить сетку (4), прокладку (2) и шайбу (3);
- завинтить втулку (1) в колпачок;
- установить колпачки на штуцеры «ВХОД ПРОБЫ» и «СБРОС ПРОБЫ».

3.4 Проверка работоспособности газоанализаторов

3.4.1 Проверку работоспособности газоанализаторов следует проводить:

- перед вводом в эксплуатацию;
- при подготовке газоанализаторов к периодической поверке.

3.4.2 Средства проверки работоспособности приведены в таблице 3.6.

3.4.3 Проверку проводить по методике раздела 2 (п. 2.2.10).

Т а б л и ц а 3.6

Средства проверки работоспособности		
Наименование	Кол.	Примечание
ПЭВМ ОС Windows XP/2000/98 с установленным Windows Framework 2.0; процессор не ниже 600 МГц; ОЗУ не менее 64 Мб; COM1-порт с преобразователем USB/RS485 Bolid	1 шт.	
Мультиметр В7-80, МЕРА.411189.001 ТУ, диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 5 А	1 шт.	С газоанализатором не поставляется
Источник питания постоянного тока Б5-71/1ММ, диапазон измерения выходного напряжения от 0 до 50 В, диапазон измерения выходного тока от 0 до 10 А; ТУ 6688-001-75414802-2009	1 шт.	
Программа «DART.exe»	1 шт.	КИП
П р и м е ч а н и е - Допускается использование другого оборудования и средств измерений, обеспечивающих требуемую точность и пределы измерений		

3.5 Техническое освидетельствование

3.5.1 Газоанализаторы до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта или замены ЭХЯ подлежат первичной поверке, при эксплуатации – периодической поверке.

3.5.2 Интервал между поверками – 1 год. Поверку проводить согласно МП-242-2004-2016.

3.5.3 Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям методики поверки, признают годными к применению.

3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

3.6.1 Газоанализаторы подвергаются консервации в соответствии с ГОСТ 9.014—78 для группы III-1. Вариант временной внутренней упаковки ВУ-5, вариант защиты ВЗ-10. Срок защиты без переконсервации – 3 года.

3.6.2 Расконсервацию и переконсервацию проводить, соблюдая требования п. 1.7.4, при следующих условиях:

- а) газоанализаторы, подвергаемые консервации, должны иметь температуру, равную температуре воздуха помещения;
- б) лица, занятые расконсервацией и переконсервацией, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011—89 (респираторы, халаты, перчатки);
- в) при переконсервации допускается применять повторно неповрежденную в процессе хранения внутреннюю упаковку.

3.6.3 Расконсервация осуществляется следующим образом:

- демонтировать крышку ящика упаковочного;
- ослабить крепление шурупов и демонтировать бруски, крепящие пакеты с упакованным газоанализатором и комплектом ЗИП;
- разгерметизировать тару, снять чехлы. Полиэтиленовые чехлы взрезать ножницами аккуратно вдоль линии сварного шва. Все неповрежденные упаковочные материалы сохранять.

3.6.4 Консервацию газоанализатора после эксплуатации на объекте проводить следующим образом:

- газоанализатор, ЗИП, товаровопроводительную документацию обернуть двумя слоями бумаги парафинированной ГОСТ 9569—2006, стыки закрепить лентой скотч;
- подготовить новые мешочки с силикагелем - силикагель сушить в сушильном шкафу при (150 – 180) °С в течение 3 – 4 ч для удаления адсорбированной влаги;
- упаковываемый газоанализатор поместить в два чехла из пленки полиэтиленовой ГОСТ 10354—82 толщиной не менее 150 мкм, размером 80x80 см, во внутренний пакет вложить 1,0 кг силикагеля технического ГОСТ 3956—76, расфасованного в мешочки;
- пакеты заварить, предварительно удалив воздух. Для удаления избыточного воздуха из чехла после заделки последнего шва откачать воздух вакуум-насосом до слабого прилегания пленки чехла к газоанализатору с последующей заклейкой отверстия лентой скотч или заваркой;

ВНИМАНИЕ: ВРЕМЯ ОТ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЛИКАГЕЛЯ В ЧЕХЛЕ ДО ОКОНЧАНИЯ СВАРКИ ПОСЛЕДНЕГО ШВА ЧЕХЛА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 2 Ч!

- изделия, входящие в комплект ЗИП, обернуть в два слоя бумаги двухслойной упаковочной по ГОСТ 8828—89 или парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—2006, края бумаги зафиксировать лентой липкой скотч, после чего поместить в два чехла из пленки полиэтиленовой во внутренний пакет вложить 0,5 кг силикагеля технического, расфасованного в мешочки;

- ЭД уложить в полиэтиленовый чехол, чехол заварить, удалив воздух;
- уложить упакованные пакеты с газоанализатором, комплектом ЗИП и ЭД в ящик упаковочный в том же порядке, в котором он был упакован предприятием-изготовителем. Закрепить брусками с помощью шурупов;
- крышку ящика закрепить гвоздями.

Средства консервации и расходные материалы приведены в таблице 3.7.

Т а б л и ц а 3.7

Средства консервации		
Наименование	Кол.	Примечание
Вакуум-насос	1 шт.	С газоанализатором не поставляется
Шкаф сушильный, рабочая температура (150 – 180) °С, объем рабочей камеры 80 дм ³	1 шт.	
Ножницы	1 шт.	
Ключ гаечный	1 шт.	
Расходные материалы		
Наименование	Кол.	Примечание
Бумага парафинированная ГОСТ 9569—2006	5 м ²	Поставляются по отдельному заказу
Лента скотч	10 м	
Пленка полиэтиленовая СТ, рукав, 0,15х (1600х2) высший сорт, ГОСТ 10354—82	1 м	
Бумага двухслойная упаковочная ДБ-1200 ГОСТ 8828—89	6 м ²	
Силикагель технический ГОСТ 3956—76	1 кг	
Гвозди ГОСТ4028—63		
П1,2x16	20 г	
П2,5x60	150 г	

3.6.5 Для проведения расконсервации необходимо ослабить крепление брусков, вывинтив шурупы. Внешние полиэтиленовые чехлы врезать ножницами аккуратно вдоль линии сварного шва, снять наружные чехлы, заменить мешочки с силикагелем. Все неповрежденные упаковочные материалы сохранять. После замены мешочеков с силикагелем внешние полиэтиленовые чехлы запаять, удалив воздух. Запаянные пакеты уложить в ящик упаковочный, закрепив их брусками с помощью шурупов.

3.6.6 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации газоанализаторов заносятся в ИБЯЛ.413411.054 ФО2.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Организация ремонта

4.1.1 В процессе эксплуатации газоанализаторы подвергаются текущему ремонту, осуществляющему методом ремонта эксплуатирующей организацией.

П р и м е ч а н и е – Агрегатный метод ремонта с заменой печатных узлов применяется при среднем и капитальном ремонте и осуществляется фирменным методом на предприятии-изготовителе.

4.1.2 Текущий ремонт газоанализаторов должен осуществляться специалистами, изучившими эксплуатационную документацию, знающими правила эксплуатации электроустановок, сдавшими экзамены по технике безопасности и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

4.1.3 Проведение текущего ремонта одного газоанализатора должно выполняться силами одного специалиста.

4.1.4 Содержание работ по текущему ремонту:

- а) замена ЭХЯ, выработавшей свой ресурс;
- б) замена фильтра поглотителя.

4.1.5 Перечень средств измерений, используемых при ремонте газоанализаторов, приведен в таблице 4.1.

Т а б л и ц а 4.1

Наименование, обозначение средства измерений, его основная характеристика	Наименование ремонтируемых составных частей газоанализаторов
Мультиметр В7-80, МЕРА.411189.001 ТУ, диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 5 А	ЭХЯ
	Фильтр поглотитель

4.2 Меры безопасности

4.2.1 При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать указания раздела 3 (п. 3.2) настоящего РЭ.

4.3 Требования на дефектацию

4.3.1 Требования на дефектацию газоанализаторов приведены в карте дефектации и ремонта (таблица 4.2)

Таблица 4.2

Карта дефектации и ремонта газоанализатора				
Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта	Требования после ремонта
Выдача непрерывной световой индикации красного цвета СИГНАЛИЗАЦИЯ и фиксированного значения тока $(1,0 \pm 0,2)$ мА в линию выходного сигнала постоянного тока	ВК, ИК	Мультиметр В7-80, МЕРА.411189.001 ТУ, диапазон измерений силы постоянного тока от 0 до 5 А	Замена ЭХЯ	Прекращается постоянное свечение световой индикации СИГНАЛИЗАЦИЯ и значение выходного сигнала постоянного тока соответствует действительному значению содержания определяемого компонента
Нестабильность показаний в линии выходного сигнала постоянного тока, после проведения корректировки чувствительности	ВК, ИК		Замена фильтра поглотителя	Соответствие значения выходного сигнала постоянного тока газоанализатора действительному значению содержания определяемого компонента

4.3.2 Сводные данные о параметрах и характеристиках газоанализаторов и его составных частей, при которых составные части газоанализаторов подлежат ремонту; с которыми их выпускают из ремонта; при которых они могут быть допущены к эксплуатации без ремонта приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Наименование параметра (характеристики) газоанализаторов и их составных частей	Значения параметров (характеристик) газоанализаторов		
	при которых изделия подлежат ремонту	с которыми их выпускают из ремонта	при которых они могут быть допущены к эксплуатации без ремонта
Световая индикация красного цвета СИГНАЛИЗАЦИЯ погашена. Показания газоанализатора, зарегистрированные на экране ПЭВМ, не должны превышать действительное значение содержания определяемого компонента, вычисленное по формуле (1.1), на величину $\pm 0,2\Delta_d$ ($0,2\delta_d$)	Более $\pm 0,2\Delta_d$ ($0,2\delta_d$)	Менее $\pm 0,2\Delta_d$ ($0,2\delta_d$)	Отсутствуют
Показания газоанализатора, зарегистрированные на экране ПЭВМ, после проведения корректировки не должны превышать действительное значение содержания определяемого компонента, вычисленное по формуле (1.1), на величину $\pm 0,2\Delta_d$ ($0,2\delta_d$)	Более $\pm 0,2\Delta_d$ ($0,2\delta_d$)	Менее $\pm 0,2\Delta_d$ ($0,2\delta_d$)	Отсутствуют

4.4 Текущий ремонт составных частей газоанализаторов

4.4.1 Замена ЭХЯ, выработавшей свой ресурс

4.4.1.1 Средства для замены ЭХЯ приведены в таблице 4.4.


Т а б л и ц а 4.4

Инструменты		
Наименование	Кол.	Примечание
Ключ разводной КР-19	1 шт.	КИП
Ключ разводной КР-30	1 шт.	
Ключ рожковый 5,5x7	1 шт.	
Ключ рожковый 8x10	1 шт.	
Ключ рожковый 10x11	1 шт.	
Ключ шестигранный S6	1 шт.	
Отвертка шлицевая 100x5	1 шт.	
Отвертка крестовая №3, 150 мм	1 шт.	
Расходные изделия		
Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.125-01	1 шт.	Поставляется по отдельному заказу


4.4.1.2 Элементы, участвующие при замене ЭХЯ, приведены на рисунке 4.1.

4.4.1.3 Замену ЭХЯ проводить в следующей последовательности:

- выключить питание газоанализатора;
- открутить винты (см. рисунок 1.1 поз. 3), используя ключ шестигранный из комплекта ЗИП, и открыть крышку (см. рисунок 1.1 поз. 2);
- используя ключ рожковый 8x10 из комплекта ЗИП, открутить винт нажимной (см. рисунок 4.1 поз. 7) и гайку накидную (см. рисунок 4.1 поз. 9);
- отсоединить от платы газоанализатора штекеры (см. рисунок 4.1 поз. 3 и поз. 4);
- используя ключ разводной КР-19 из комплекта ЗИП, выкрутить из корпуса штуцер «ВХОД ПРОБЫ» (см. рисунок 1.1 поз. 14);
- используя отвертку шлицевую из комплекта ЗИП, открутить два винта, крепящие планку (см. рисунок 4.1 поз.15). Снять планку и отсоединить разъемы ламп индикационных от платы, отсоединить разъем ЭХЯ от платы;
- используя отвертку крестовую из комплекта ЗИП, открутить четыре винта (см. рисунок 4.1 поз. 8);
- извлечь из корпуса блок аналитический (см. рисунок 4.1 поз. 1);

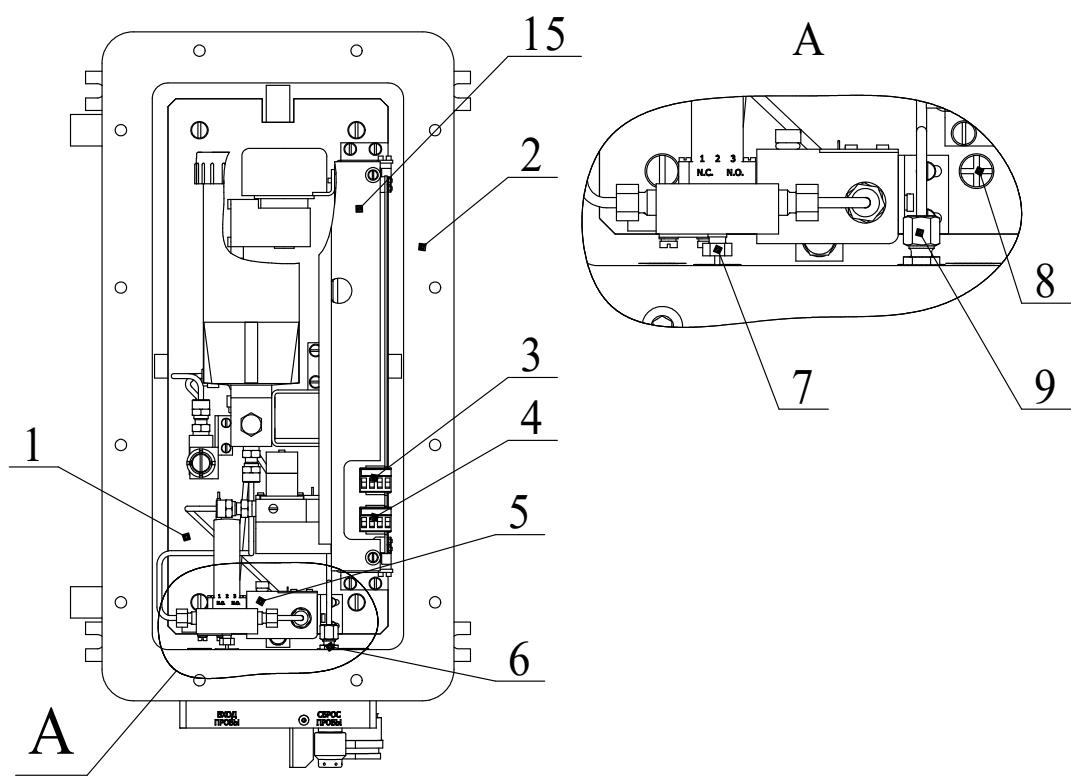

Блок аналитический
(извлечен из корпуса поз.2)

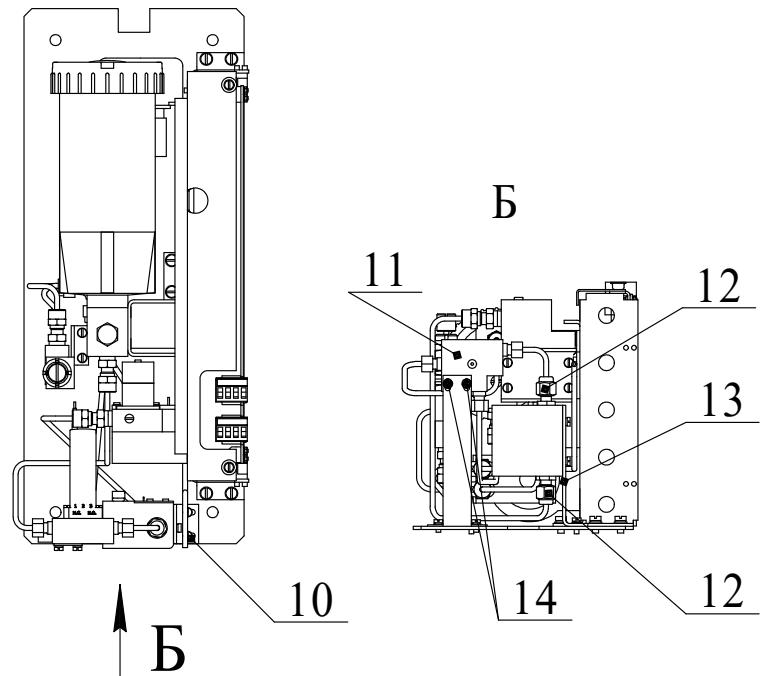

1 - блок аналитический;
2 - корпус;
3 - штекерная часть с винтовыми зажимами
для подключения кабеля связи с ВУ по интерфейсу
RS485, токовый выход;
4 - штекерная часть с винтовыми зажимами для
подключения кабеля питания;
5 - ячейка электрохимическая;
6 - штуцер "СБРОС ПРОБЫ";

7 - винт нажимной;
8 - винт крепления блока аналитического.
9 - гайка накидная;
10 - винт крепления кронштейна ячейки;
11 - клапан;
12 - гайка накидная;
13 - кронштейн;
14 - винт крепления клапана;
15 - планка.

Рисунок 4.1 – Замена ЭХЯ

- используя ключ разводной КР-19 из комплекта ЗИП, ослабить гайки накидные (см. рисунок 4.1 поз. 12) фитингов, которые фиксируют металлические трубы ввода/вывода пробы ЭХЯ. При этом удерживать от выворачивания корпуса фитингов с помощью ключа рожкового 10x11;

- используя отвертку шлицевую из комплекта ЗИП, открутить два винта (см. рисунок 4.1 поз. 10) и два винта (см. рисунок 4.1 поз. 14);

- освободить металлические трубы ввода/вывода пробы ЭХЯ и демонтировать ЭХЯ совместно с кронштейном (см. рисунок 4.1 поз. 13);

- открутить отверткой шлицевой винты крепления ЭХЯ к кронштейну;

- установить на кронштейн новую ЭХЯ;

- закрепить ЭХЯ при помощи крепежных винтов;

- подсоединить металлические трубы к фитингам ЭХЯ, затянуть накидные гайки фитингов;

- подключить электрический разъем ЭХЯ к плате;

- провести сборку в обратной последовательности;

- закрыть крышку газоанализатора, соблюдая последовательность закручивания крепежных винтов, указанную в разделе 2 (см. рисунок 2.1);

- газоанализатор включить, прогреть;

- провести корректировку чувствительности газоанализатора в соответствии с указаниями раздела 3 настоящего РЭ (п. 3.3).

4.4.2 Замена фильтра поглотителя

4.4.2.1 Замену фильтра поглотителя провести в соответствии с указаниями раздела 3 настоящего РЭ (п. 3.3.5).

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение газоанализаторов в упаковке соответствует условиям группы 3 (Ж3) по ГОСТ 15150—69. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

5.2 В местах хранения газоанализаторов в окружающем воздухе должны отсутствовать кислоты, щелочи, другие агрессивные примеси, вызывающие коррозию, а также токопроводящая пыль.

5.3 Условия хранения газоанализаторов после снятия упаковки не должны отличаться от рабочих условий эксплуатации и должны соответствовать температуре окружающего воздуха от 1 до 45 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % при температуре 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

5.4 В условиях складирования газоанализаторы должны храниться на стеллажах.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Условия транспортирования оборудования должны соответствовать:

- в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23216—78;
- в части воздействия климатических факторов – условиям хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69.


6.2 Газоанализаторы в транспортной таре должны допускать транспортировку на любые расстояния автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), водным транспортом (в трюмах судов), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках) в соответствии с документами, действующими на данных видах транспорта.

6.3 Размещение и крепление транспортной тары с упакованными газоанализаторами в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными газоанализаторами от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

6.4 При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на таре и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности газоанализаторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Датчики-газоанализаторы паров КРТ ДАРТ. Монтажный чертеж

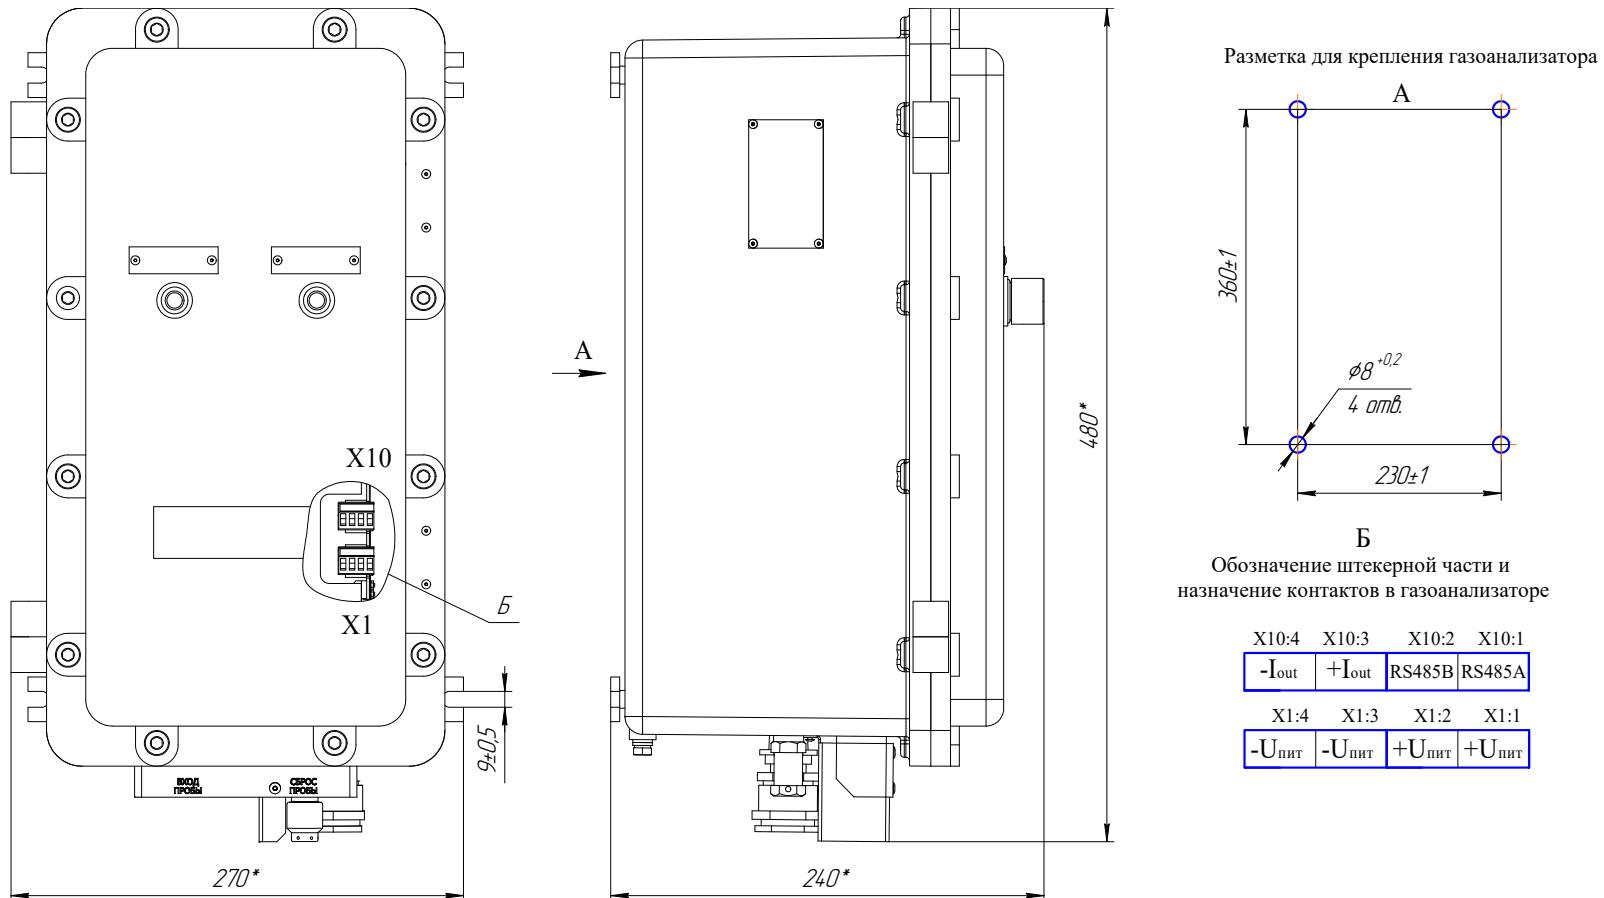

1 * Размеры для справок.
 2 Монтаж вести согласно разделу 2 ИБЯЛ.413411.054 РЭ2.
 3 Электрический монтаж вести бронированным кабелем.

П р и м е ч а н и е - Омическое сопротивление линии связи - не более 10 Ом на жилу.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**(справочное)****Описание регистров и команд, используемых газоанализаторами
по цифровому каналу связи с протоколом MODBUS RTU**

Б.1 Газоанализаторы поддерживают следующие команды логического протокола обмена «MODBUS RTU»:

- «03h» – команда чтения нескольких регистров;
- «10h» - команда записи нескольких регистров.

Скорость обмена – 9600 бод.

Б.2 Формат команды «Чтение регистров – 03h».

Данная команда предназначена для считывания текущих показаний газоанализаторов, установленных значений порогов срабатывания сигнализации ПОРОГ1, ПОРОГ2, сигнализации ОТКАЗ, контрольной суммы ПО, версии ПО.

В регистрах хранения с 00 по 05 хранятся измеренные значения содержания определяемого компонента, значения установленных порогов срабатывания сигнализации, в регистрах 34 – 37 – контрольная сумма и версия ПО. Назначение регистров хранения представлено в таблице Б.1.

Таблица Б.1

	Тип данных				
	Измеренное значение содержания определяемого компонента	Установленное значение порога 1	Установленное значение порога 2	Контрольная сумма ПО	Версия ПО
Номера регистров	0000, 0001	0002, 0003	0004, 0005	34, 35	36, 37

Форма представления данных в регистрах приведена в таблице Б.2.

Таблица Б.2.

Регистр 0 (2,4)															
Байт 1								Байт 2							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
ЗНАК	-	О	-	-	А	А	А	0-9				0-9			
Регистр 1 (3,5)															
Байт 3								Байт 4							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0-9				0-9				0-9				0-9			

Продолжение приложения Б

П р и м е ч а н и я

- 1 Бит О указывает на состояние сигнализации «ОТКАЗ»;
 - «1» – сигнализация сработала;
 - «0» – не сработала.

2 Бит ЗНАК:

- 0 – измеренное значение положительно;
 - 1 – измеренное значение отрицательно.

3 Биты А,А,А – положение запятой в измеренном значении (количество цифр после запятой).

4 Байты 2, 3, 4 – измеренное значение (цифры от 0 до 9 десятичные).

Пример – Число «12,3456» будет записано в виде 04h,12h,34h,56h число «-0,987654» – 86h,98h,76h,54h.

Команда запроса данных имеет вид:

N, 03h, NH, NL, KH, KL, CRC1, CRC0,

где N – номер газоанализатора в информационной сети; устанавливается пользователем в диапазоне от 1 до 128;

NH, NL – номер первого считываемого регистра;

KH, KL – количество считываемых регистров;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитывается в соответствии с протоколом «MODBUS RTU».

Пример запроса данных об измеренном значении содержания определяемого компонента:

N, 03h, 00h, 00h, 00h, 02h, CRC1, CRC0.

Б.3 Формат команды «Запись нескольких регистров – 10h».

Б.3.1 Команда записи нескольких регистров «10h» предназначена для установки значений порогов срабатывания сигнализации, номера газоанализатора в информационной сети, корректировки показаний.

Б.3.2 Команда на установку номера газоанализатора в информационной сети имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – текущий номер газоанализатора в информационной сети. В случае, когда пользователь не знает текущий номер данного устройства, возможно применение широковещательного режима работы. При этом к информационной сети должно быть подключено только то устройство, которому устанавливают номер, а текущий номер N в посылке заменяется на «00»;

Продолжение приложения Б

set – команда на установку номера газоанализатора – 20h;

BH, BL, BIH, BIL – новый номер газоанализатора в информационной сети, формат данных BCD приведен в таблице Б.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

Б.3.3 Для корректировки показаний газоанализаторов используются следующие команды:

- команда на корректировку нулевых показаний газоанализатора имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – ранее присвоенный номер газоанализатора в информационной сети;

set – команда на корректировку нулевых показаний – 01h;

BH, BL, BIH, BIL – содержание определяемого компонента в подаваемой ПГС согласно расчетным значениям расхода на выходе генераторов ГГС-Р и ТДГ-01, мг/м³, формат данных BCD приведен в таблице Б.2. Для нулевого газа, используемого в качестве ПГС № 1: BH, BL, BIH, BIL – 00h, 00h, 00h, 00h;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU;

- команда на корректировку чувствительности газоанализаторов имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – номер газоанализатора в информационной сети;

set – команда на корректировку чувствительности – 02h;

BH, BL, BIH, BIL – действительное значение массовой концентрации поверочного компонента в ПГС, определенное в соответствии с МИ, мг/м³, формат данных BCD приведен в таблице Б.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

Б.3.4 Для установки значений порогов срабатывания сигнализации используются следующие команды:

- команда на установку значения ПОРОГ 1 имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – номер газоанализатора в информационной сети;

set – команда на установку значения ПОРОГ 1 – 03h;

BH, BL, BIH, BIL – значение порога, формат данных BCD приведен в таблице Б.2;

Продолжение приложения Б

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU;

- команда на установку значения ПОРОГ 2 имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – номер газоанализатора в информационной сети;

set – команда на установку значения ПОРОГ 2 – 04h;

BH, BL, BIH, BIL – значение порога, формат данных BCD приведен в таблице Б.2;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

Б.3.5 Команда «Сброс сигнализации» имеет вид:

N, 10h, 00h, 20h, 00h, 03h, 06h, 00h, set, BH, BL, BIH, BIL, CRC1, CRC0,

где N – номер газоанализатора в информационной сети;

set – команда «Сброс сигнализации» – 20h;


BH,BL,BIH,BIL – не содержит данных;

CRC1, CRC0 – контрольная сумма CRC16, рассчитанная в соответствии с протоколом MODBUS RTU.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Схема пломбировки газоанализаторов от несанкционированного доступа

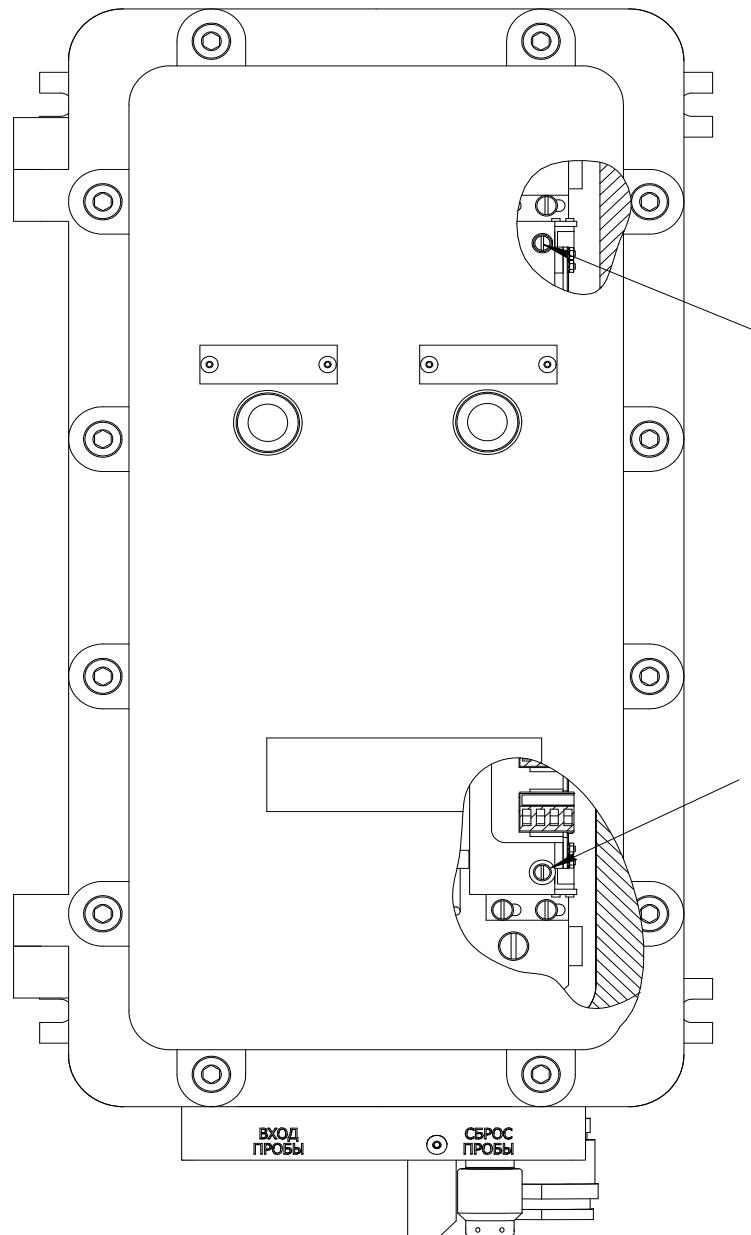

Стрелкой указано место пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места для нанесения оттисков клейм.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Технические характеристики ПГС, используемой при корректировке чувствительности газоанализаторов

№ ПГС	Компонентный состав	Единица физической величины	Характеристики ПГС			Номер ПГС по Госреестру
			Содержание проверочного компонента	Пределы допускаемого отклонения, мг/м ³	Пределы допускаемой относительной погрешности аттестации, %	
3	Гидразин-гидрат $N_2H_4 \cdot H_2O$	мг/м ³	0,8	$\pm 0,1$	**	*
П р и м е ч а н и я						
1 * ПГС получена в соответствии с МИ 243/01-2016.						
2 ** - в соответствии с МИ 243/01-2016.						
3 Относительная влажность ПГС составляет $(60 \pm 3) \%$.						

Приложение Д
(справочное)

Инструкция по применению раствора гипохлорита натрия

Д.1 Общие положения

Д.1.1 Гипохлорит натрия марки А (далее - ГХН), ГОСТ 11086-76 является солью хлорноватистой кислоты. Раствор получают заводским способом — поглощением хлора раствором едкого натра. Раствор ГХН марки А — прозрачная зеленовато-желтая жидкость (допускается взвесь) с содержанием активного хлора 17 %.

На заводах-изготовителях растворы ГХН заливают в стальные гуммированные цистерны или контейнеры, а также в полиэтиленовые канистры или бочки емкостью 20—60 л. Раствор ГХН разлагается при хранении, в связи с чем его хранят в закрытом, сухом, прохладном, хорошо проветриваемом нежилом помещении.

В виду слабой стойкости раствора ГХН и возможных нарушений правил хранения и приготовления рабочих растворов необходимо проводить проверку препаратов и приготовленных рабочих растворов иодометрическим методом на содержание активного хлора. Гипохлорит обладает бактерицидным и спорицидным действием.

Д.2 Меры личной профилактики

Д.2.1 При выполнении очистительных работ раствором ГХН каждый работающий обязан строго соблюдать меры личной безопасности, для чего следует пользоваться индивидуальными средствами защиты (респиратор РУ-60 с патроном марки А; защитные очки, резиновые перчатки; защитные передники). При попадании раствора ГХН на кожу и слизистую глаз необходимо быстро и обильно промыть струей чистой воды.

Д.3 Приготовление рабочих растворов гипохлорита натрия

Д.3.1 Очистку оборудования, контактировавшего с гидразин-гидратом, проводят методом полного его заполнения 5 % водным раствором ГХН на 30 мин.

Д.3.2 Для точного приготовления рабочих растворов реагента с требуемой концентрацией по активному хлору необходимо руководствоваться следующим расчетом:

1) молярная масса ГХН (химическая формула - NaOCl) равна 74,5 г/моль, в которой содержится Cl в количестве 35,5 г/моль.

Массовая концентрация активного хлора в ГХН марки А, по ГОСТ 11086-76, - 190 г/дм³.

Значит количество ГХН марки А в 1 литре раствора составляет

$$M_{\text{ГХН}} = \frac{74,5 \cdot 190}{35,5} = 398,7 \text{ г} \quad (\text{Д.1})$$

Плотность раствора ГХН (ρ) марки А равна 1,26 г/см³;

Продолжение приложения Д

2) рассчитаем необходимое количество ГХН, требуемое для получения 1000 мл 5 % водного раствора ГХН по формуле

$$m = 0,05 \cdot 1000 \cdot 1,26 = 63 \text{ г}, \quad (\text{Д.2})$$

что по активному хлору составляет 30,02 г;

3) исходя из того, что в 1 л раствора ГХН марки А, по ГОСТ 11086-76, содержится 190 г хлора, рассчитываем количество ГХН (дм^3) на 1 л рабочего раствора (5 %) с содержанием активного хлора 30 г по формуле

$$X_1 = \frac{30}{190} = 0,158; \quad (\text{Д.3})$$

4) таким образом для получения 1 л 5 % водного раствора гипохлорита натрия марки А, изготовленного по ГОСТ 11086-76, необходимо затратить 0,158 дм^3 (V) раствора ГХН, который необходимо растворить в 0,842 дм^3 воды.

Масса ГХН

$$m_1 = V \cdot \rho = 0,158 \cdot 1,26 = 0,199 \text{ кг};$$

5) для получения 5 л 5 % водного раствора гипохлорита натрия марки А, изготовленного по ГОСТ 11086-76, необходимо затратить

$$m_1 = 0,199 \cdot 5 = 0,995 \text{ кг.}$$

Д.4 Результат

Д.4.1 Для приготовления 5 % водного раствора из ГХН (далее - очистительный раствор) с концентрацией активного хлора 190 г/дм³ необходимо 0,995 кг реагента растворить в небольшом количестве воды, перемешать и объем довести до 5 дм³.

Д.5 Применение

Д.5.1 По завершению работ с гидразин-гидратом склянки с содержимым необходимо опустить в приготовленный очистительный раствор (5 л) гипохлорита натрия и выдержать 30 мин.

Д.5.2 Затем очистительный раствор слить в канализацию, после чего склянки промыть три раза дистиллированной водой и высушить.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АЭС	- атомные электростанции;
ВК	- визуальный контроль;
ВУ	- внешние устройства;
ЗИП	- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей;
ИК	- измерительный контроль;
КИП	- комплект инструмента и принадлежностей ИБЯЛ.413944.064-01;
КЗЧ	- комплект запасных частей ИБЯЛ.413943.045;
КРТ	- компоненты ракетного топлива;
МИ	- МИ 243/01-2016 «Методика измерений массовой концентрации паров гидразина (гидразин-гидрата) в газовых смесях с азотом (воздухом) фотометрическим методом»;
МП	- методика поверки МП-242-2004-2016;
ПГС	- поверочная газовая смесь;
ПДК	- предельно-допустимая концентрация по ГОСТ 12.1.005-88;
ПО	- программное обеспечение;
ПЭВМ	- персональная электронно-вычислительная машина;
РЭ	- руководство по эксплуатации часть 3 ИБЯЛ.413411.054 РЭ2;
ТО	- техническое обслуживание;
ФО	- формуляр часть 3 ИБЯЛ.413411.054 ФО2;
ЭД	- эксплуатационная документация;
ЭХЯ	- электрохимическая ячейка.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
					66			